

SETUP SHEET

RT-4551KV5 & RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Patient Name:


Patient ID #:

Setup by:

Physician:

Date:

Comments:

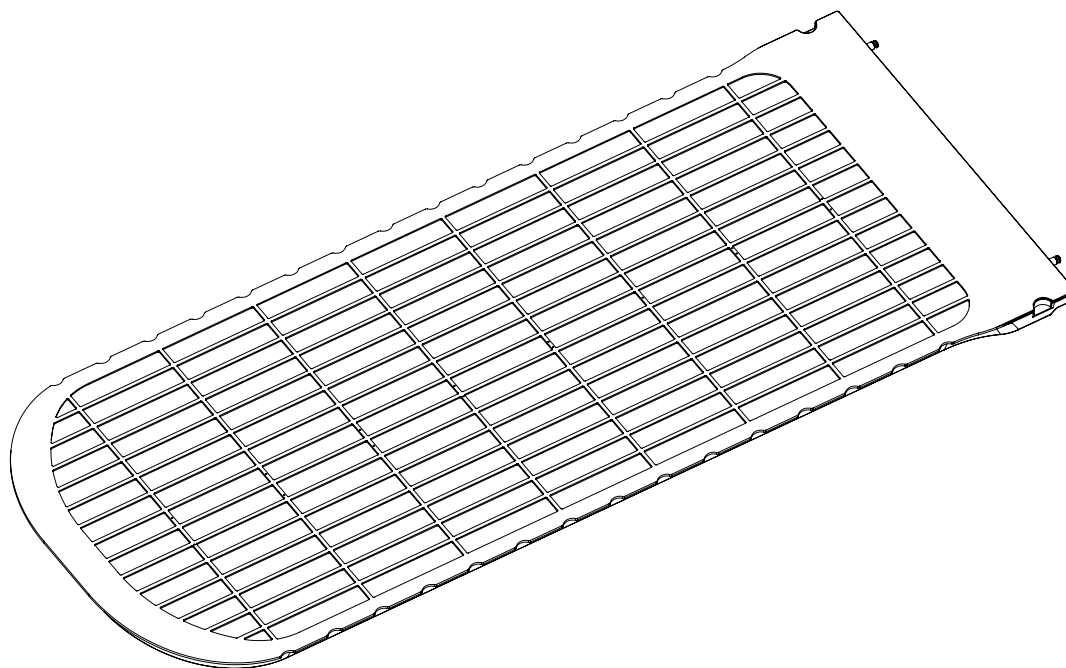

Moving Rails Location:

Notes:

INSTALAČNÍ LIST

RT-4551KV5 A RT-4551KV18 – NÁSTAVEC KVUE DOSEMAX

Jméno pacienta::


ID pacienta:

Nastavení provedl(a):

Lékař:

Datum:

Komentář:

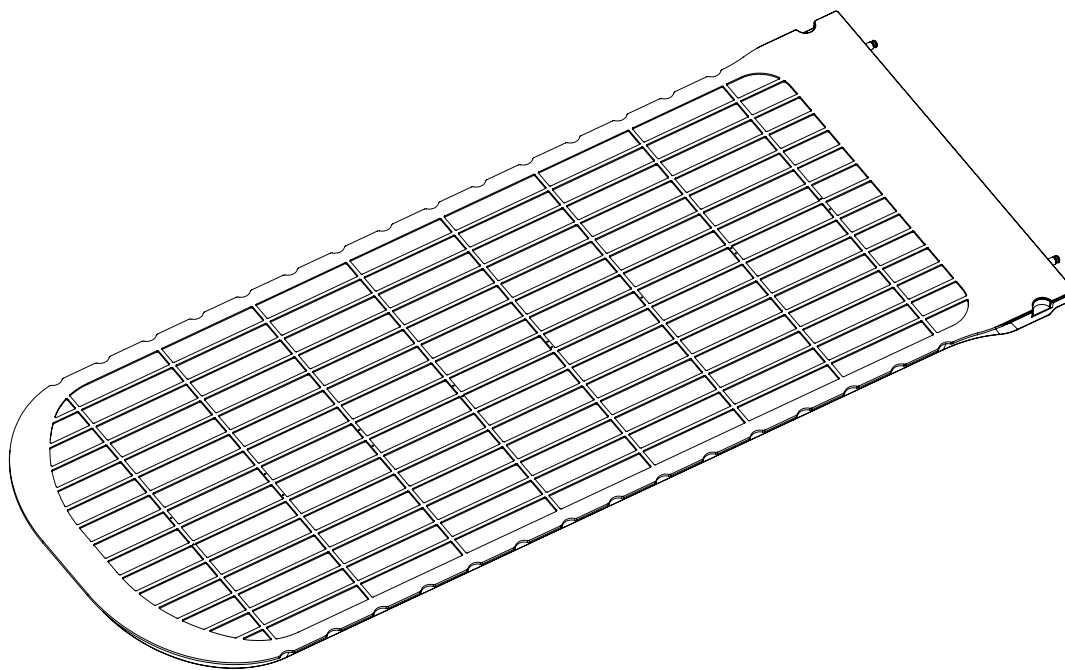

Umístění pohyblivé lišty:

Poznámky:

OPSÆTNINGSARK

RT-4551KV5 OG RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Patientens navn:


Patient-ID nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:

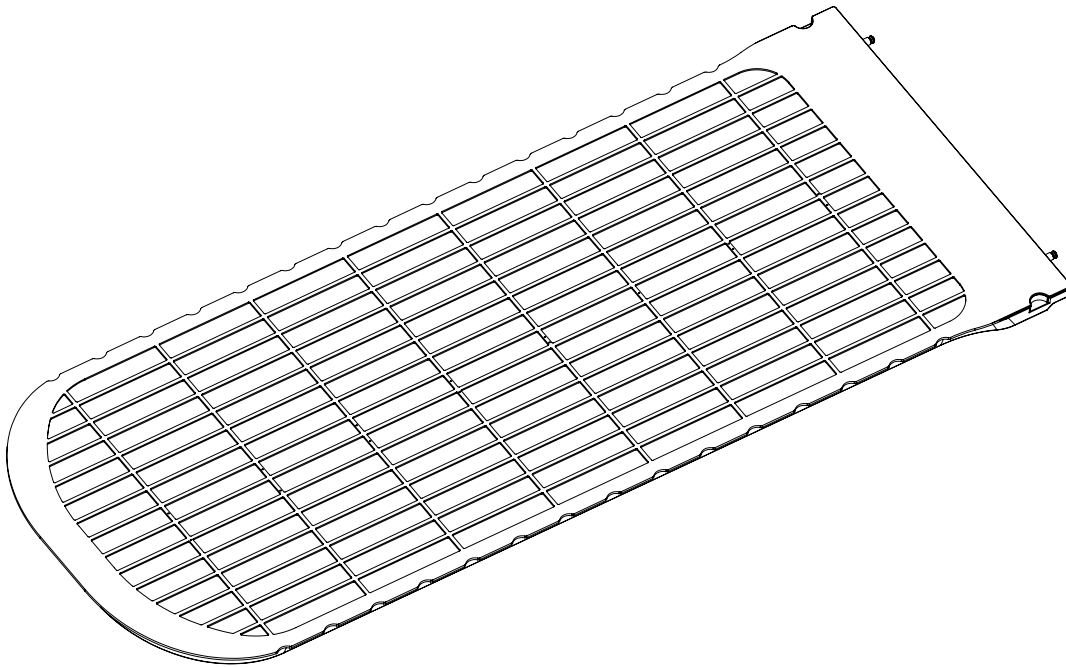

Placering af bevægelig skinne:

Bemærkninger:

EINSTELLUNGSBLATT

RT-4551KV5 UND RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Name des Patienten


Patienten-Nr.:

Eingerichtet von:

Arzt:

Datum:

Kommentare:

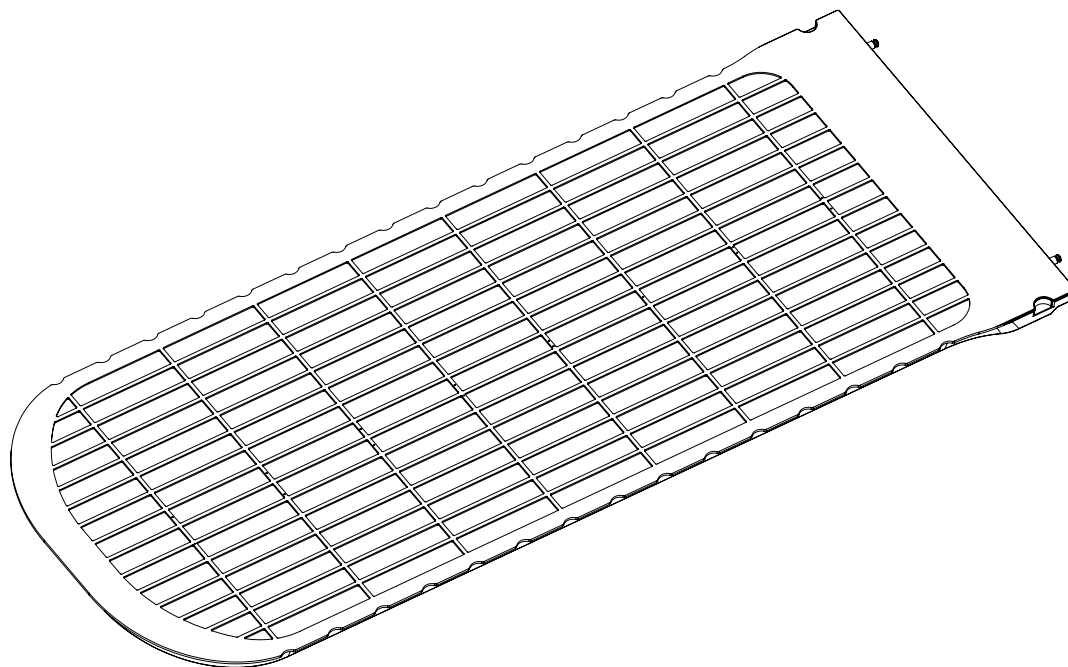

Position der Verfahrsschiene:

Notizen:

HOJA DE PREPARACIÓN

RT-4551KV5 Y RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Nombre del paciente:


N.º de ID del paciente:

Preparación realizada por:

Médico:

Fecha:

Comentarios:

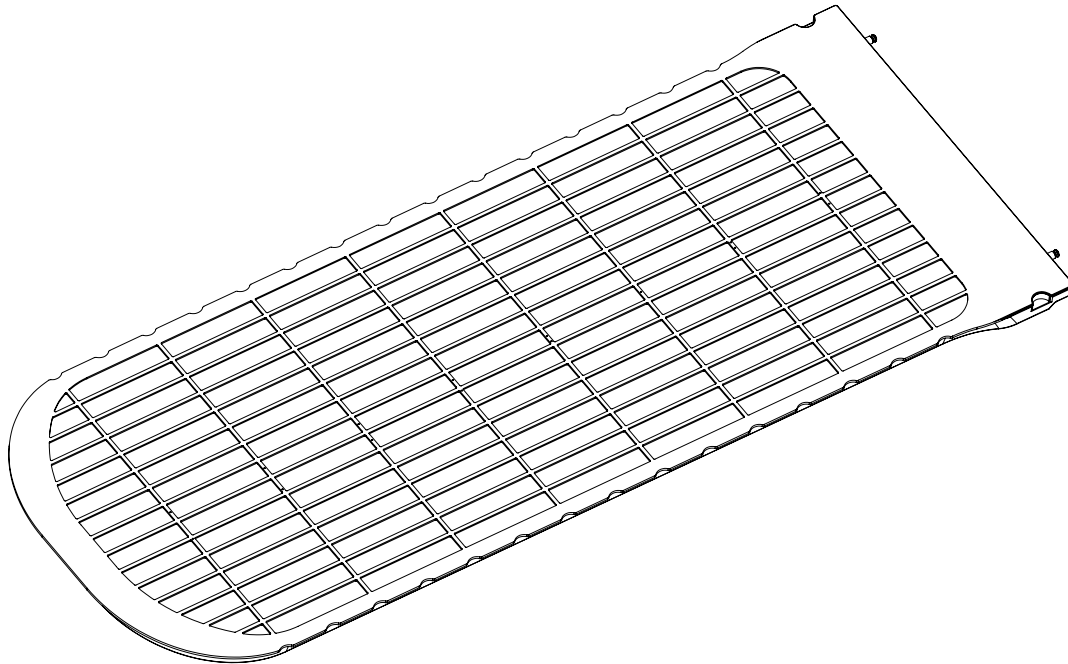

Posición del carril de movimiento:

Notas:

SEADISTUSLEHT

RT-4551KV5 JA RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAXI KATE

Patsiendi nimi:


Patsiendi tunnusnumber:

Häälestaja:

Arst:

Kuupäev:

Kommentaariid:

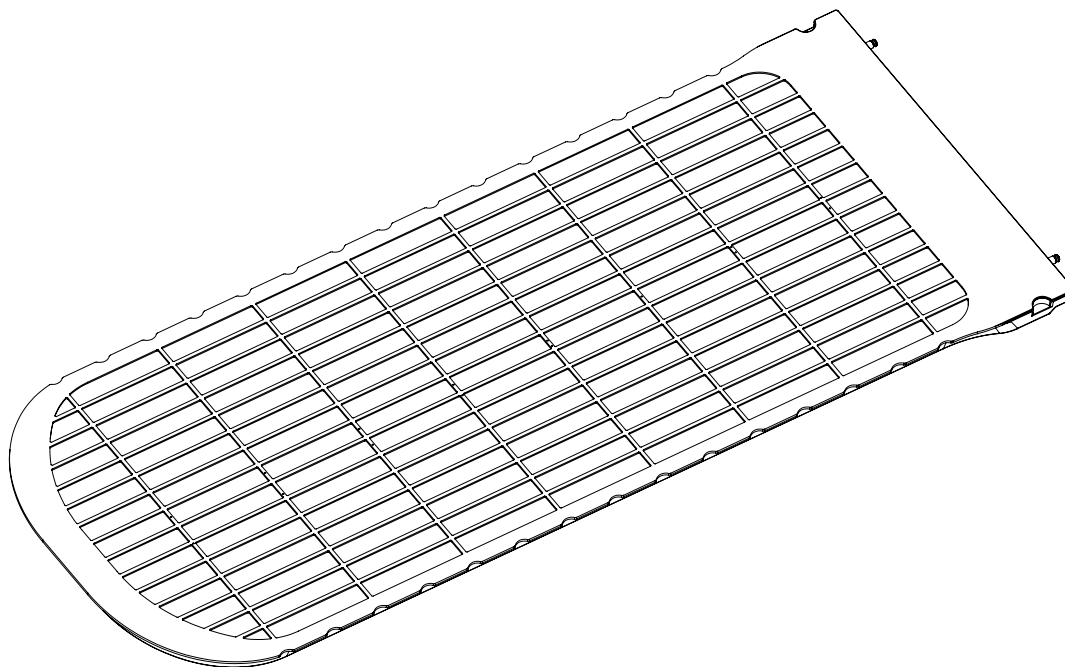

Liikuva raami asukoht:

Märkused:

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4551KV5 JA RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Lääkäri:

Muistiinpanot:

Asentaja:

Pvm:

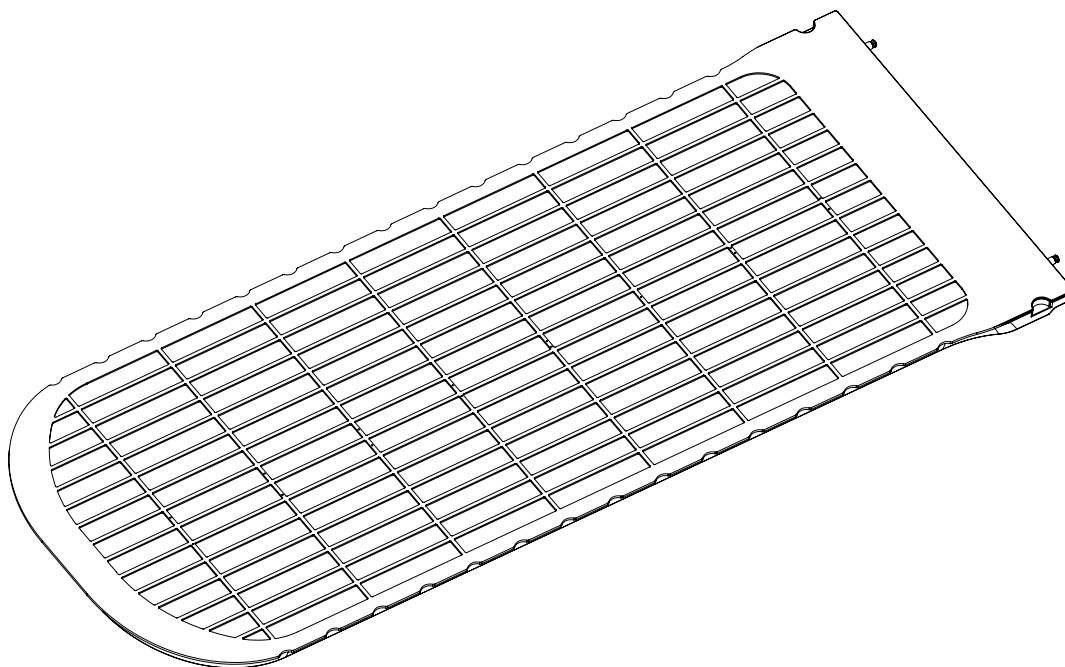

Liikkuvan kiskon sijainti:

Muistiinpanot:

FEUILLE D'INSTALLATION

RT-4551KV5 ET RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Nom du patient :


N° d'identification du patient:

Installé par :

Médecin :

Date:

Commentaires :

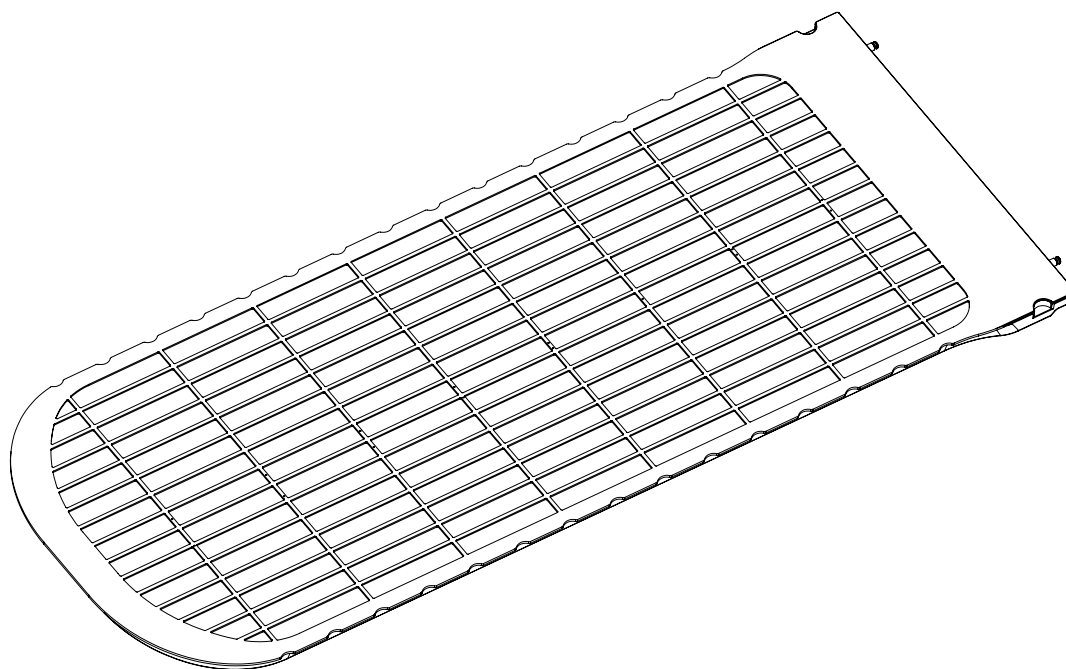

Emplacement du rail mobile :

Remarques :

POZICIONÁLÁSI LAP

RT-4551KV5 ÉS RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX BETÉT

Beteg neve:


Betegazonosító szám:

Pozicionálást végezte:

Orvos:

Dátum:

Megjegyzések:

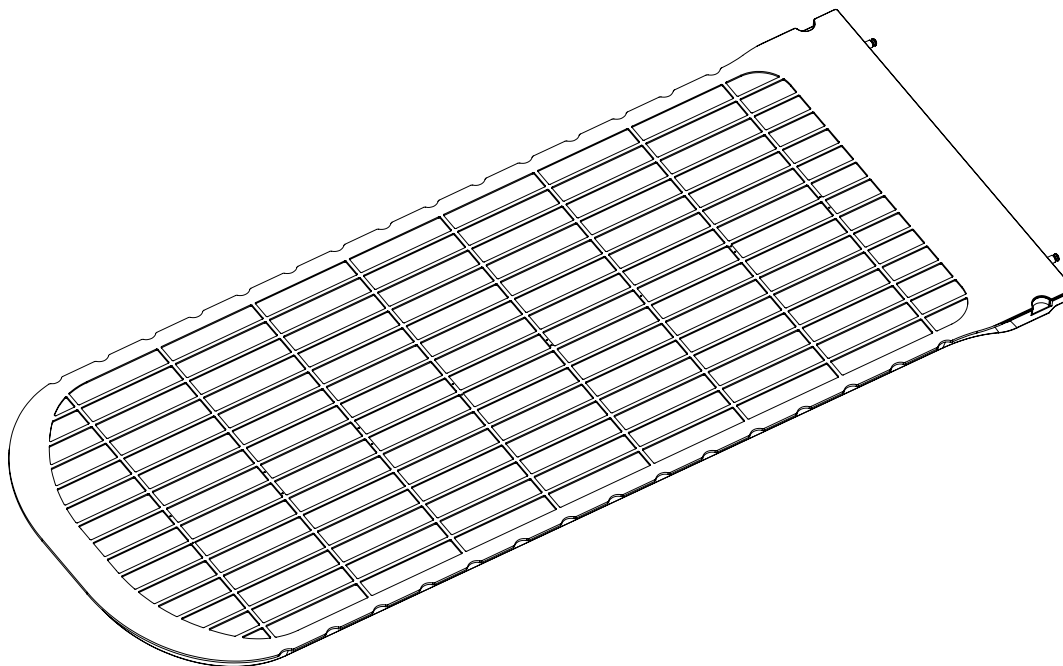

Mozgósín helye:

Megjegyzések:

FOGLIO DI APPRONTAMENTO

RT-4551KV5 E RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Nome paziente:


ID paziente:

Approntato da:

Medico:

Data:

Commenti:

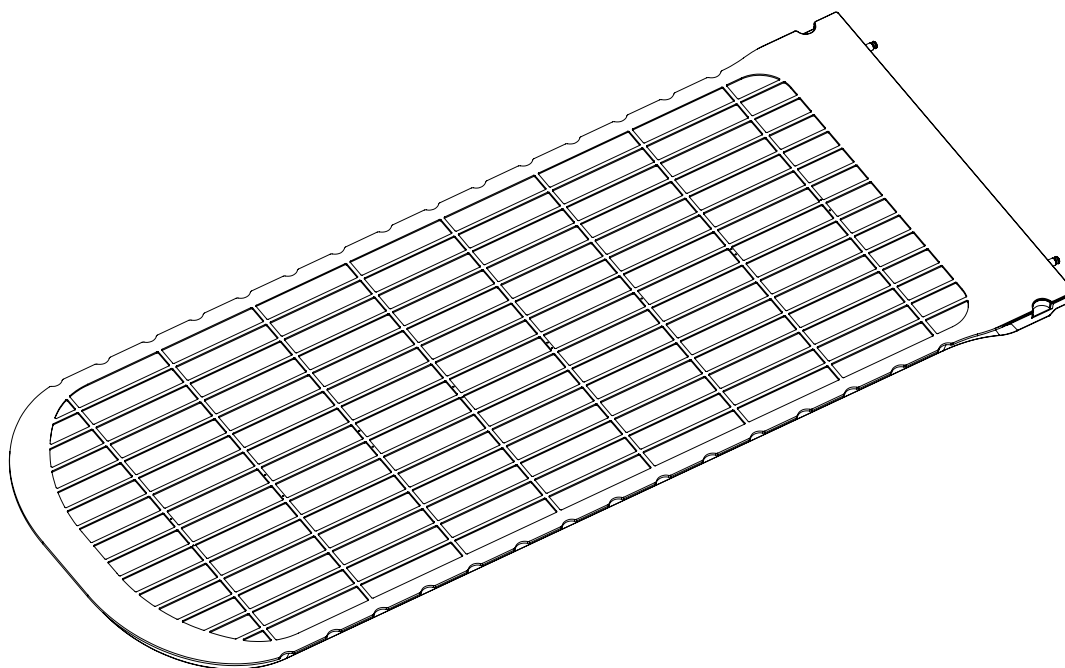

Ubicazione binario mobile:

Nota:

セットアップシート

RT-4551KV5 そして RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

患者名:


患者ID番号:

セットアップ担当者:

医師:

日付:

コメント:

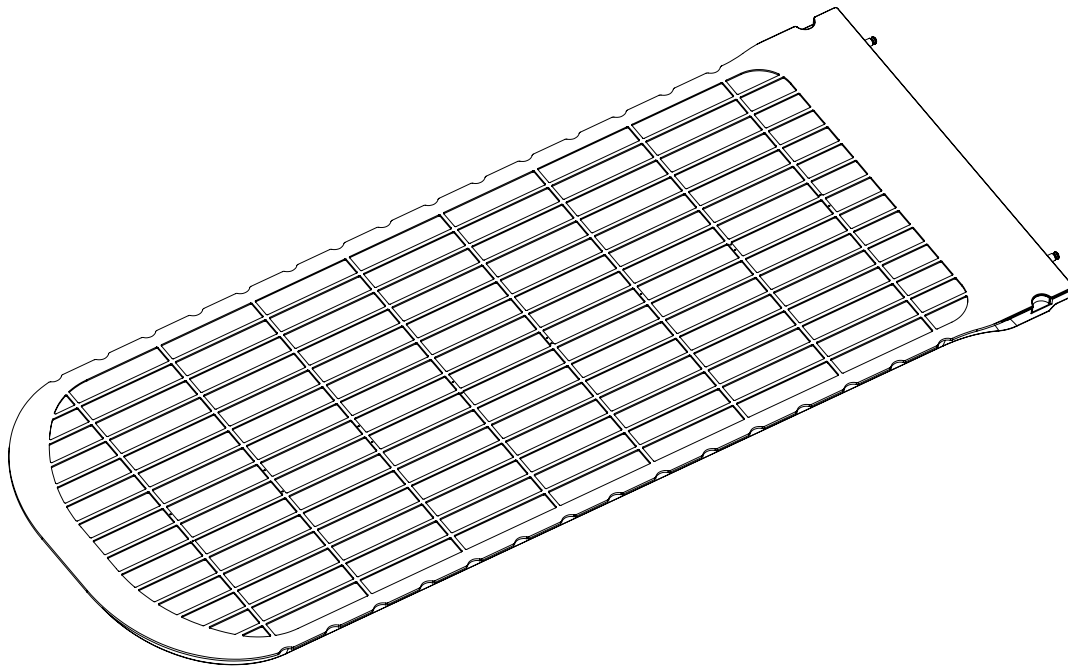

可動式レールの位置:

注記:

준비 시트

RT-4551KV5 및 RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX 인서트

환자 이름:


환자 ID 번호:

준비자:

의사:

날짜:

의견:

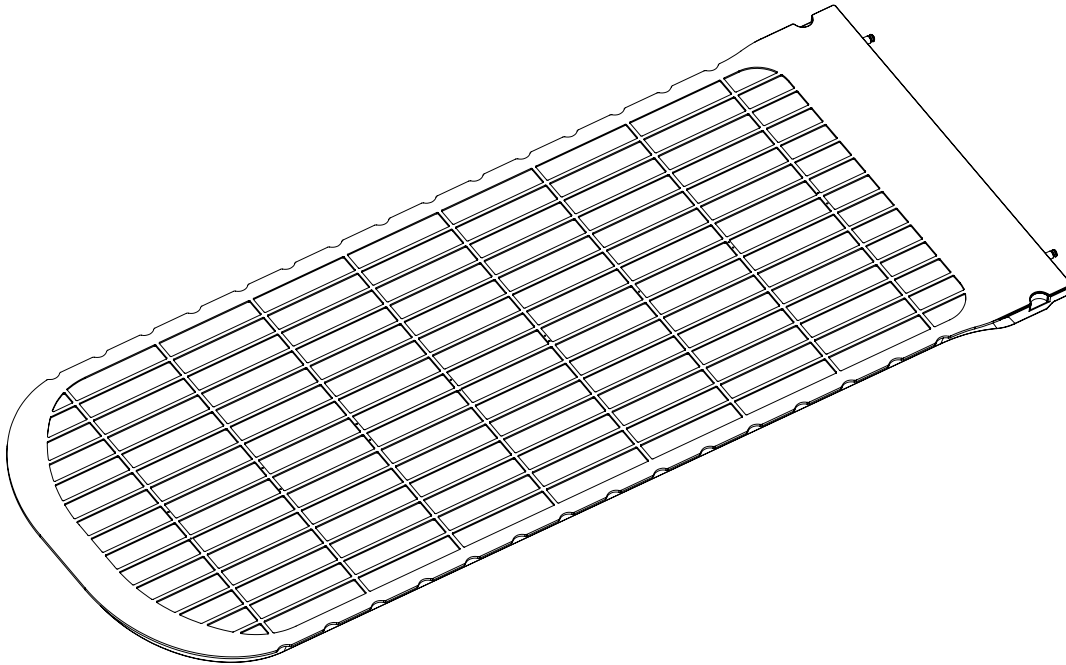

이동 레일 위치:

참고사항:

OPPSETTARK

RT-4551KV5 OG RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX-INNSATS

Navn på pasient:


Pasient-ID:

Satt opp av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:

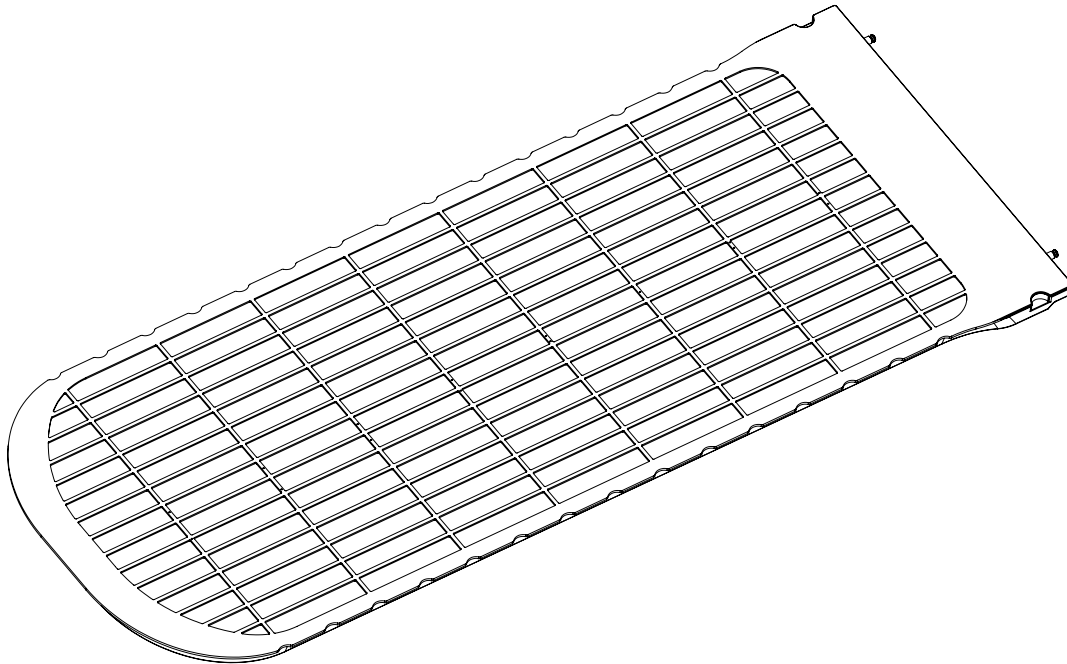

Plassering av flyttbar skinne:

Merknader:

ARKUSZ KONFIGURACJI

RT-4551KV5 I RT-4551KV18 – WKŁADKA KVUE DOSEMAX INSERT

Nazwisko pacjenta:


Nr pacjenta:

Konfiguracja wykonana przez:

Lekarz:

Data:

Uwagi:

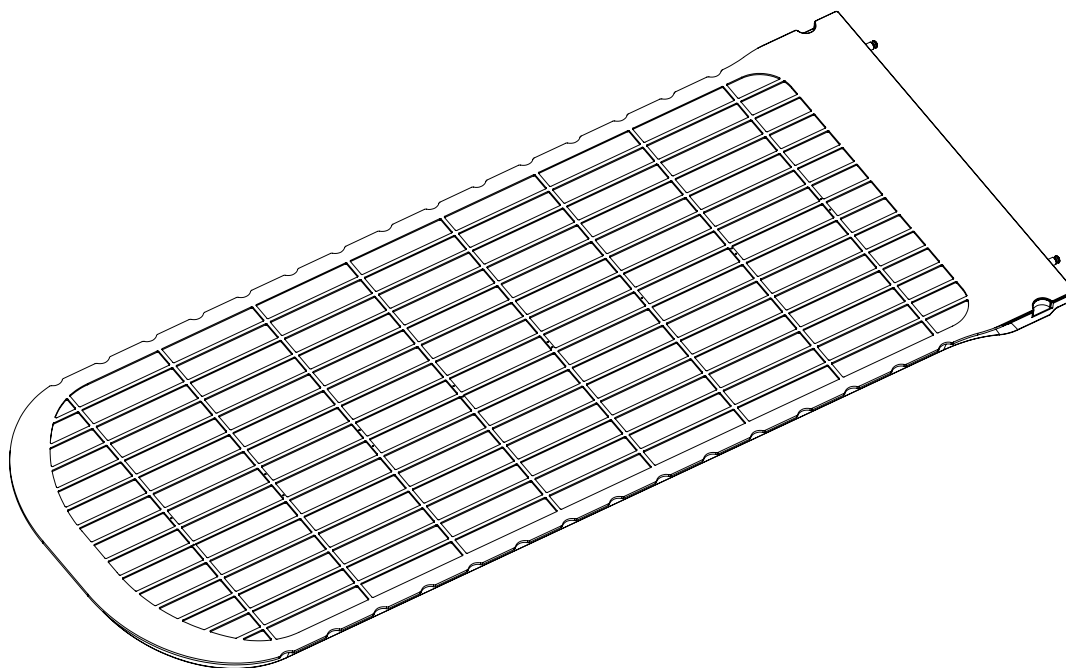

Położenia szyny ruchome:

Uwagi:

FOLHA DE AJUSTES

RT-4551KV5 E RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Nome do paciente:


Nº de ID do paciente:

Ajuste realizado por:

Médico:

Data:

Comentários:

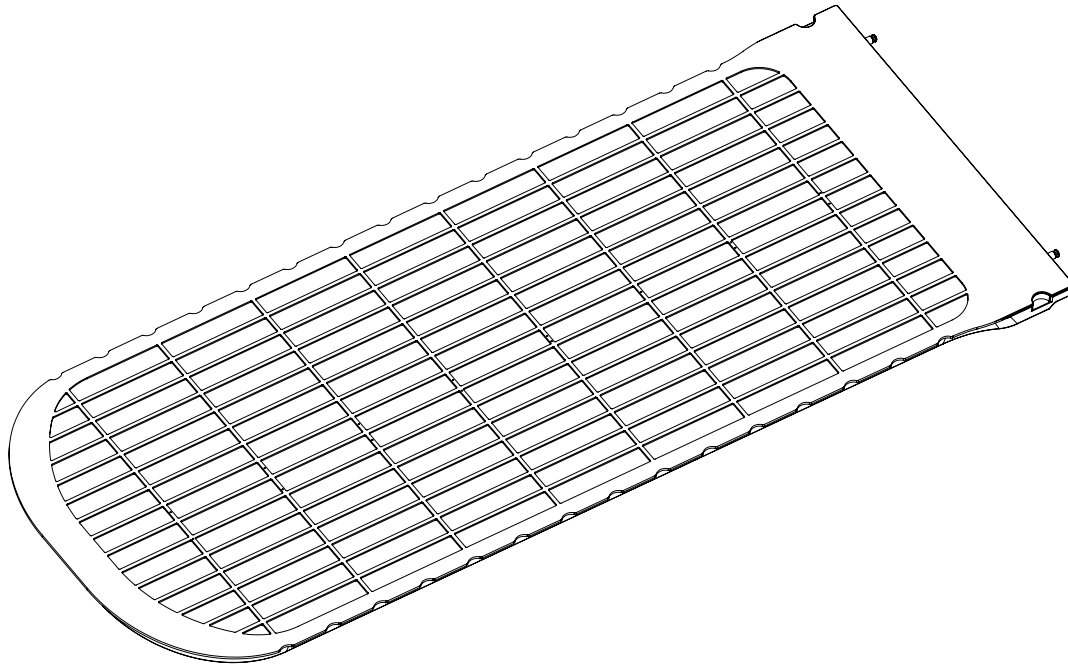

Localização do trilho móvel:

Observações:

FICHA DE CONFIGURAÇÃO

RT-4551KV5 E RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Nome do doente:


ID do doente N.º:

Configurado por:

Médico:

Data:

Comentários:

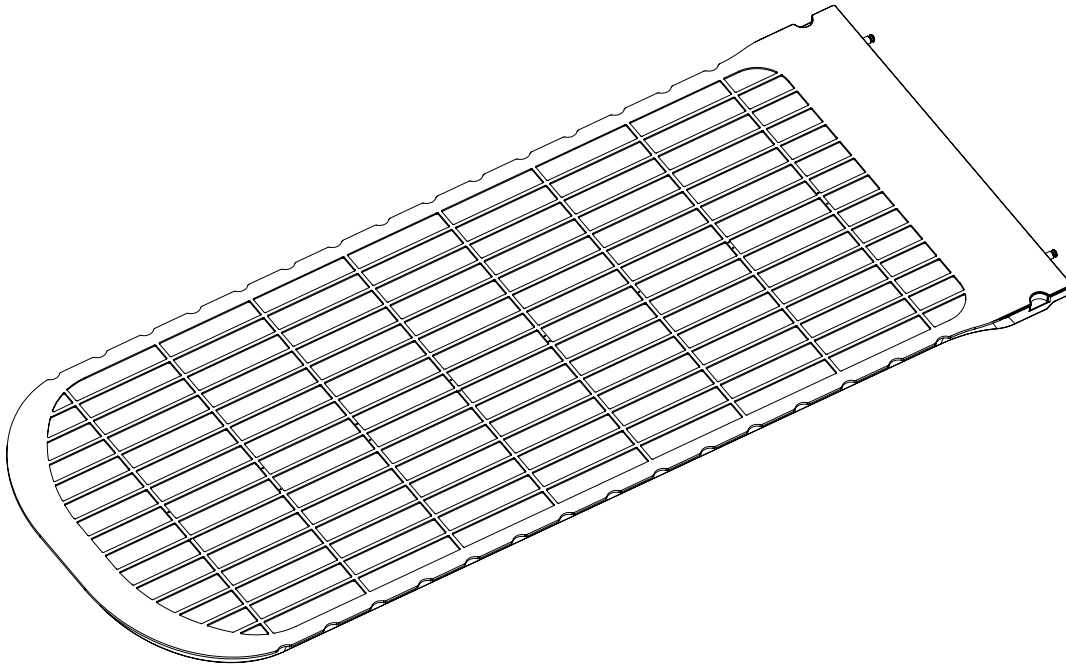

Localização de calha móvel:

Notas:

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4551KV5 ȘI RT-4551KV18 – INSERT KVUE DOSEMAX

Nume pacient:


ID pacient:

Configurat de:

Doctor:

Data:

Comentarii:

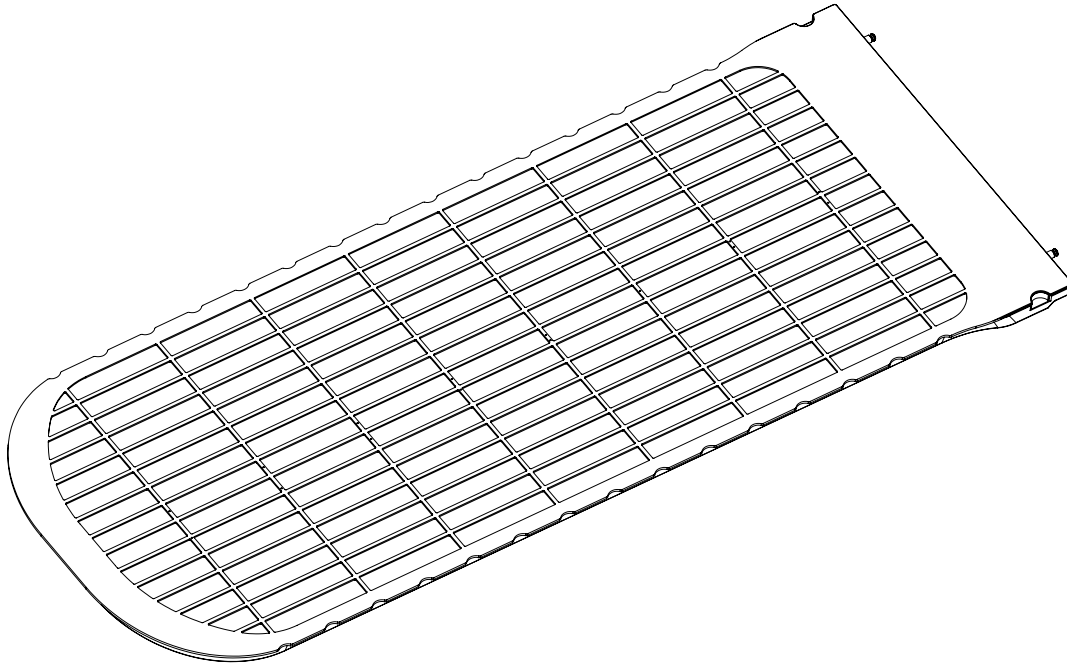

Locație șină mobilă:

Note:

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

RT-4551KV5 И RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

ФИО пациента:


Идентификационный номер пациента:

Кем разме:

Врач:

Дата:

Замечания:

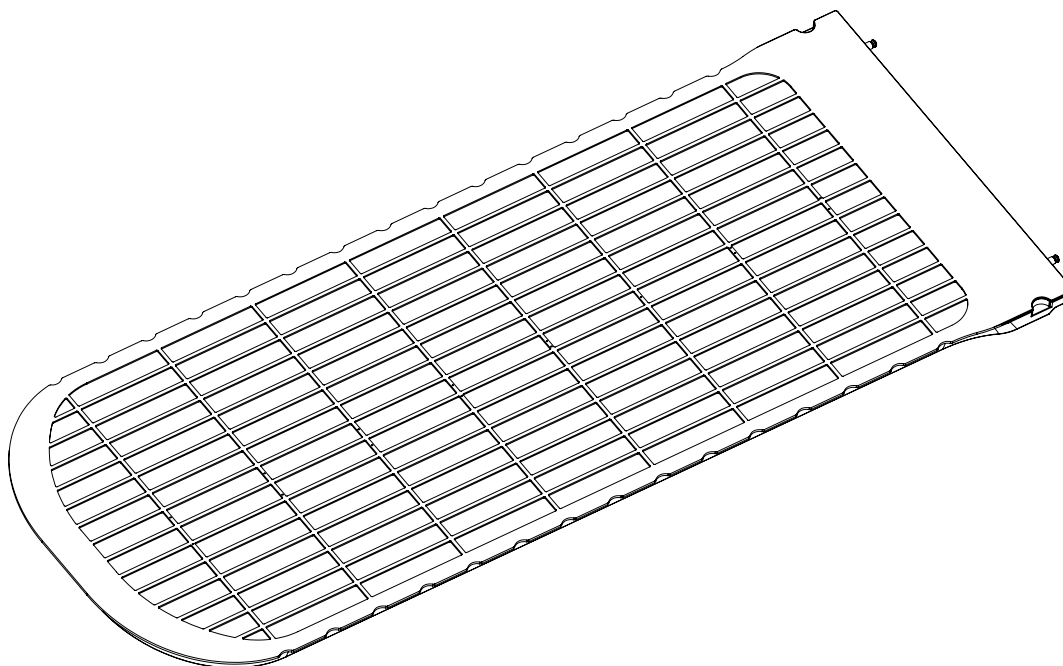

Положение подвижного поручня:

Примечания:

HÁROK NASTAVENIA

RT-4551KV5 A RT-4551KV18 – VLOŽKA KVUE DOSEMAX

Meno pacienta:


Č. identifikátora pacienta:

Nastavil(-a):

Lekár:

Dátum:

Komentáre:

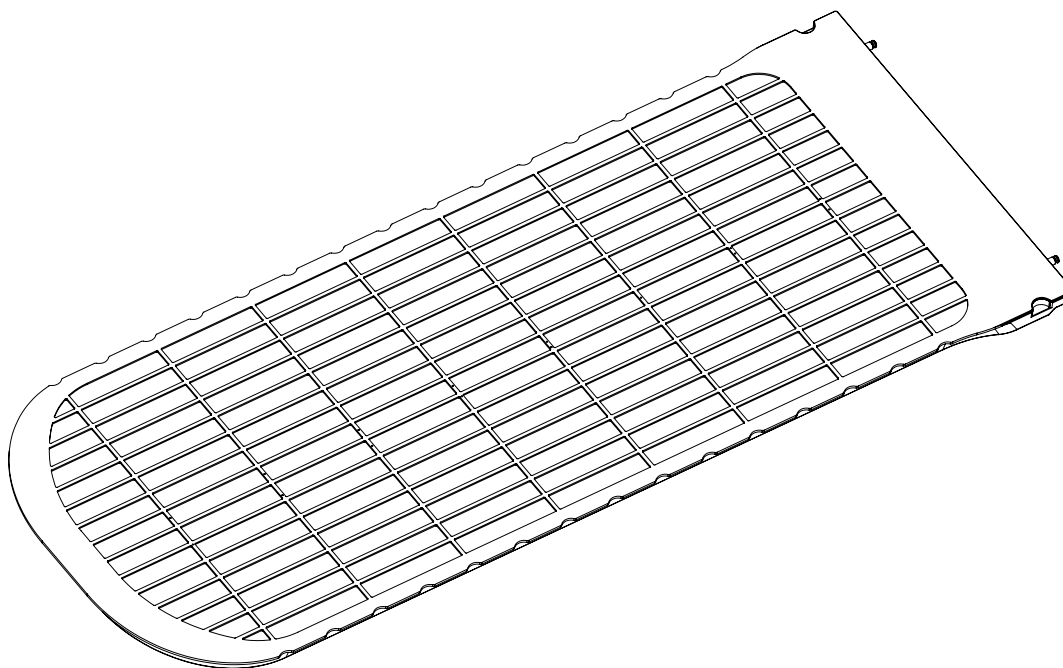

Pozícia pohyblivých koľajníc:

Poznámky:

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4551KV5 OCH RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Patientens namn:


Patient-ID:

Inställning utförd av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:

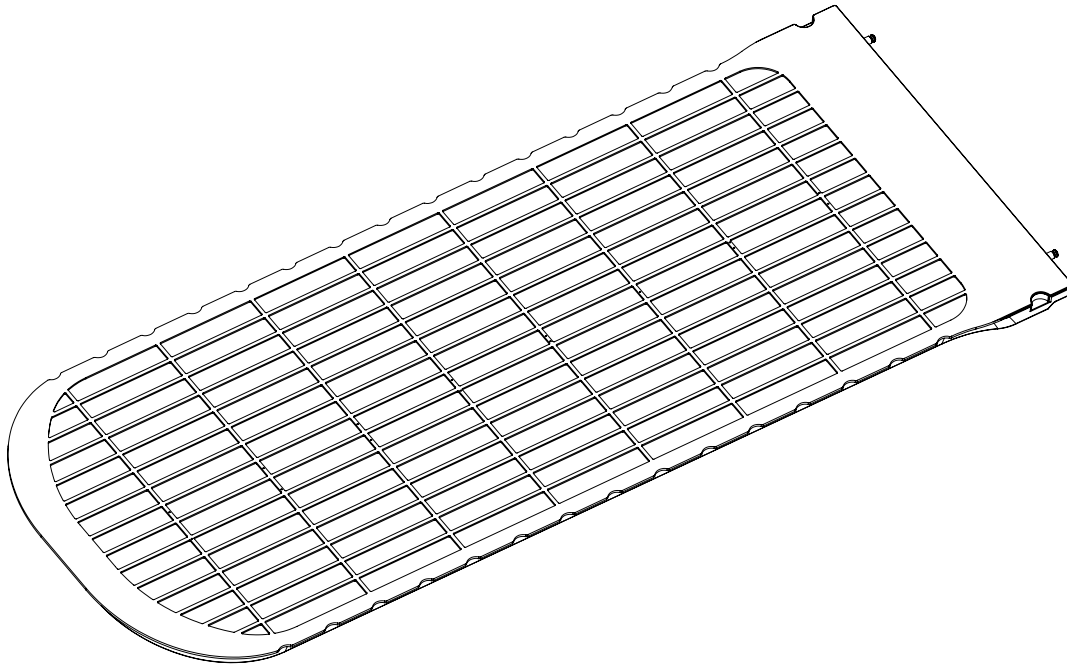

Position för skenor:

Anmärkningar:

KURULUM SAYFASI

RT-4551KV5 VE RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Tanılayıcı No.:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu Yapan:

Tarih:

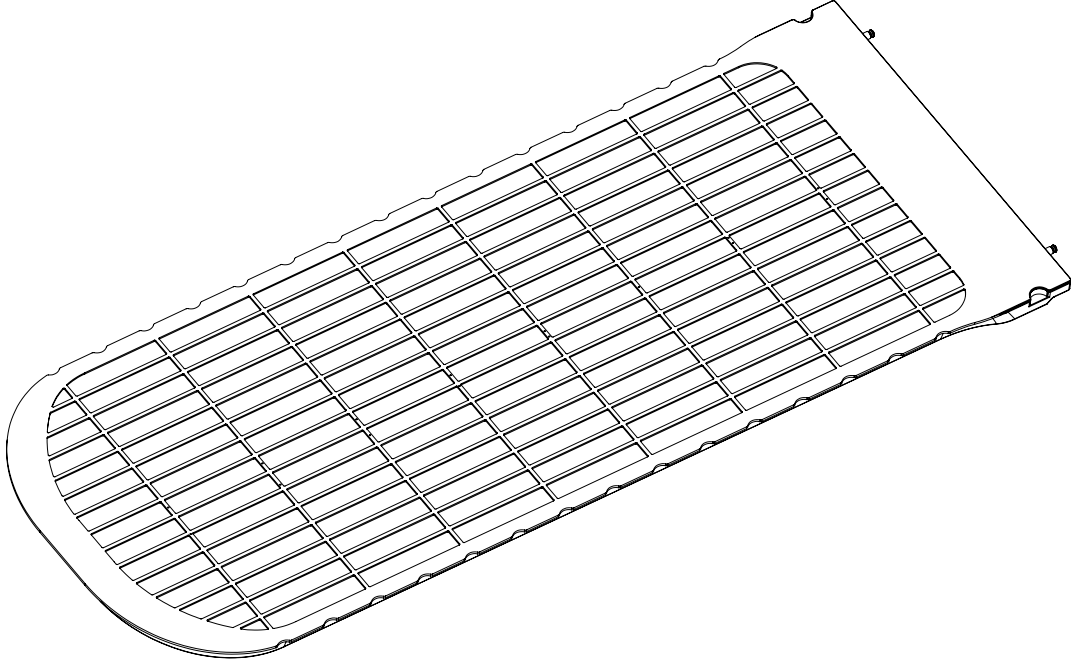

Hareketli Ray Yeri:

Notlar:

设置表

RT-4551KV5 和 RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

患者姓名:


患者编号:

设置者:

医生:

日期:

注释:

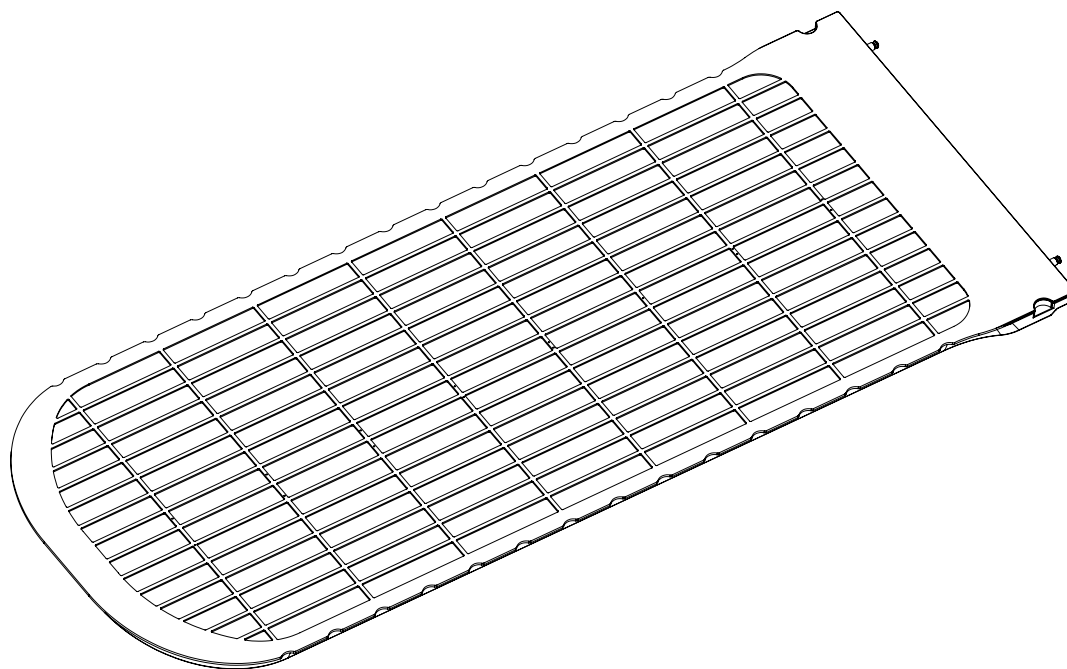

移动导轨位置:

注: