positioning
patients for life.®

製品ガイドおよび取扱説明書

RT-4544KV そして RT-4544KV-10

kVue Access 360™ そして kVue Access 360™ G2 Prone Breast カウチトップ挿入子

腹臥位用乳房カウチトップ挿入子

鎖骨上部アクセス式

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

CE

EC REP	米国での製造者名
Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com

Access 360、kVueおよびOneTouchはQfixの登録商標です。
Exact® は、Varian Medical Systems の登録商標です。
Clorox® はThe Clorox Companyの登録商標です。
Cidex® はJohnson & Johnsonの登録商標です。

目次

一般的な使用上の注意 4
- 警告事項 4
- 重大な有害事象 4
- その他の警告 4
- 治療ビームの減衰 4
- 最大安全荷重 4
- 警告ラベルおよび説明 5

用途 7

各部の機能 8
- 概要 8
- 必要な付属品 8
- KVUE™ ACCESS 360™ 構成部品 9
- KVUE™ ACCESS 360™ G2 構成部品 10
- 構成部品 11

操作方法 13
- セットアップ 13
- オーバーレイへのCTライザーとCTシムの取付け 14
- 取付け 16
- 患者のポジショニング 20

メンテナンス 22
- システムのクリーニング 22
- システムの消毒 22

仕様 23
- ACCESS 360™ 23
- ACCESS 360™ G2 24

患者のセットアップ 25
- KVUE™ ACCESS 360™カウチトップ挿入子 25
- KVUE™ ACCESS 360™ G2カウチトップ挿入子 27

部品リスト 29
- KVUE™ ACCESS 360™カウチトップ挿入子 29
- KVUE™ ACCESS 360™ G2カウチトップ挿入子 30

一般的な使用上の注意

警告事項

! 警告 !本装置を改造することはできません。本デバイスの一部が大きな荷重を受けた場合、損傷しているように見える場合、または正常に機能しない場合は、直ちに使用を中止して、QFIX社（+1 484-720-6054またはTECHSUPPORT@QFIX.COM）まで連絡してください。

! 警告 ! ONETOUCH 精密装置であり、認定済みのQFIX KVUEデバイスにのみ使用するものです。認定のないQFIX以外のデバイスは、QFIXによる検証が行われておらず、安全に使用できるかどうか分からないため、使用した場合は保証が無効となります。

! 警告 ! KVUE ACCESS 360™ そして KVUE ACCESS 360™ G2のスケールはあくまで参照用です。

重大な有害事象

重大な有害事象（例えば、死亡または重傷をもたらす、またはその可能性がある事象）があれば必ず、Qfixと、設置した国の所管官庁の両方に報告してください。

その他の警告

- **デュアルハンドグリップとハンドグリップポストは、患者の体重を支えるようには設計されていません。患者を配置するためにデュアルハンドグリップやハンドグリップポストを使用しないでください。デバイスの乗り降りにデュアルハンドグリップやハンドグリップポストを使用しないでください。**
- **患者がデバイスに乗り降りする時に、患者を手助けする必要がある場合があります。**
- **デバイスは長いため、取付けと取外しは2人で行うことが奨励されます。**
- **CTシムは一度に4つ以上重ねて使用しないでください。これを超えるとデバイスが不安定になることがあります。**

治療ビームの減衰

kVue Access 360™ そして kVue Access 360™ G2 カウチトップ挿入子の構造部分は光子線を減衰させます。設定に基づいた実際の減衰は、各施設の特定機器で検証する必要があります。どのようなデバイス（コンポジット材の構造でも）で治療を行っても、皮膚線量の増加が起こります。

最大安全荷重

200 kgの等分布加重（デバイス全体に均一にかかる荷重）、またはカウチベースの最大作業荷重のいずれか低い方を決して超えないようにしてください。

! 注記 ! OEMカウチベースと組み合わせた場合、最大安全荷重は2種類の安全作業荷重のうちの低い方となります。kVueカウチトップの荷重負荷は、カウチベースのメーカーによる元の仕様を超えてはいけません。元のメーカーが提供する製品説明書を参照してください。

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

一般的な使用上の注意

警告ラベルおよび説明

記号およびその定義に関する一覧表は、Qfix.comをご覧ください。

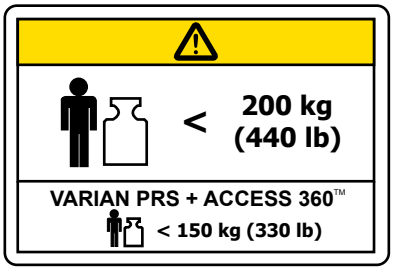

または

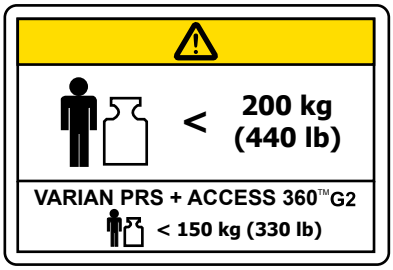

最大安全荷重

200 kgの等分布加重（デバイス全体に均一にかかる荷重）、またはカウチトップ挿入子、もしくはカウチベースの最大作業荷重のいずれか低い方を決して超えないようにしてください。

Varian PRS.と組み合わせて使用する場合は、150 kgの等分布加重を決して超えないようにしてください。

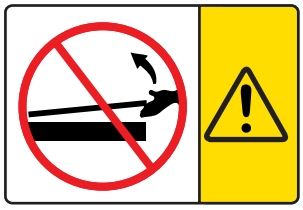

持ち上げ禁止

！警告！カウチトップ挿入子の端を決して持ち上げないでください。

連結ピンは曲がったり折れたりすることがあり、その場合カウチトップが使用できなくなることがあります。

「NO STEP（積載不可）」ライン

乳房用の切抜き部分を超えた領域は、患者の体幹上部を支持するよう設計されテストされています。これは患者の全体重を支えるようには設計されていません。

カウチトップ挿入子上の乳房用の切抜き部分を超えて立位ないし座位を取ると、カウチトップ挿入子の損傷や、患者の傷害の原因になることがあります。

一般的な使用上の注意

警告ラベルおよび説明

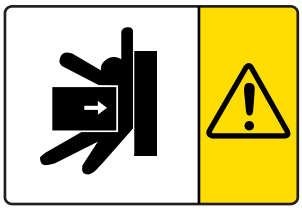

怪我の可能性

カウチトップ挿入子と治療室内のその他の機器との間に挟まって怪我をする可能性があります。怪我や事故などが起こらないように、カウチトップを動かすときは十分に注意してください。

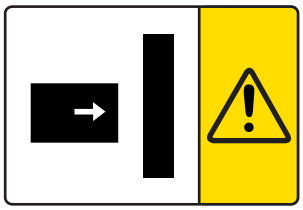

ガントリーとの衝突

カウチベースや治療用ヘッドは多方向に動くため、カウチトップ挿入子やガントリーを含む周囲の物にぶつかる恐れがあります。カウチトップやガントリーを動かす際には、装置の損傷や患者への傷害が起こらないように注意してください。

用途

本デバイスは、放射線治療を受ける患者の固定、位置決め、および再位置決めを行うためのものです。

! 注記！米国の連邦法により、本デバイスの販売または使用は、医師もしくは医師の指示に基づくものに制限されています。

対象患者

放射線療法または画像診断処置を受けている患者。

意図する使用者

製品の意図する使用者は、規制地域の要件に従って認定を受けた資格者です。

各部の機能

概要

kVue™ Access 360™ & kVue Access 360™ G2は、乳房全体、乳房部分、および加速乳房部分照射を含む、左右両方の乳房の乳癌治療ができるように設計されています。患者を腹臥位 することで、乳房と、危険にさらされる可能性のある重要臓器の分離を高めることができます これによって、心臓、肺、周囲の健常組織への暴露を最低限に抑えながら、以下が可能になり ます。

より均一な線量の照射
より低い皮膚毒性
呼吸運動の低減
流線型の一端を固定して延長する設計により、オブリーク角度とノンコプラナー照射の両方が可能になり、より高い一回線量が可能となります。ビーム路はカウチトップからの最小限の干渉で主に乳房を通るため、アーチファクトや散乱を最小限に抑えることができます。

Access Prone G2（RT-4544-01） は、Access™ 360 G2（RT-4544KV-10）のシミュレーションデバイスとして使用できます。

! 警告 ! ACCESS 360（RT-4544KV）は、自他のACCESS 360（RT-4544KV）デバイス製品以外に対しては、シミュレーションデバイスとして使用できません。

必要な付属品

CTライザー（シミュレーション用）

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

各部の機能

KVUE™ ACCESS 360™ 構成部品

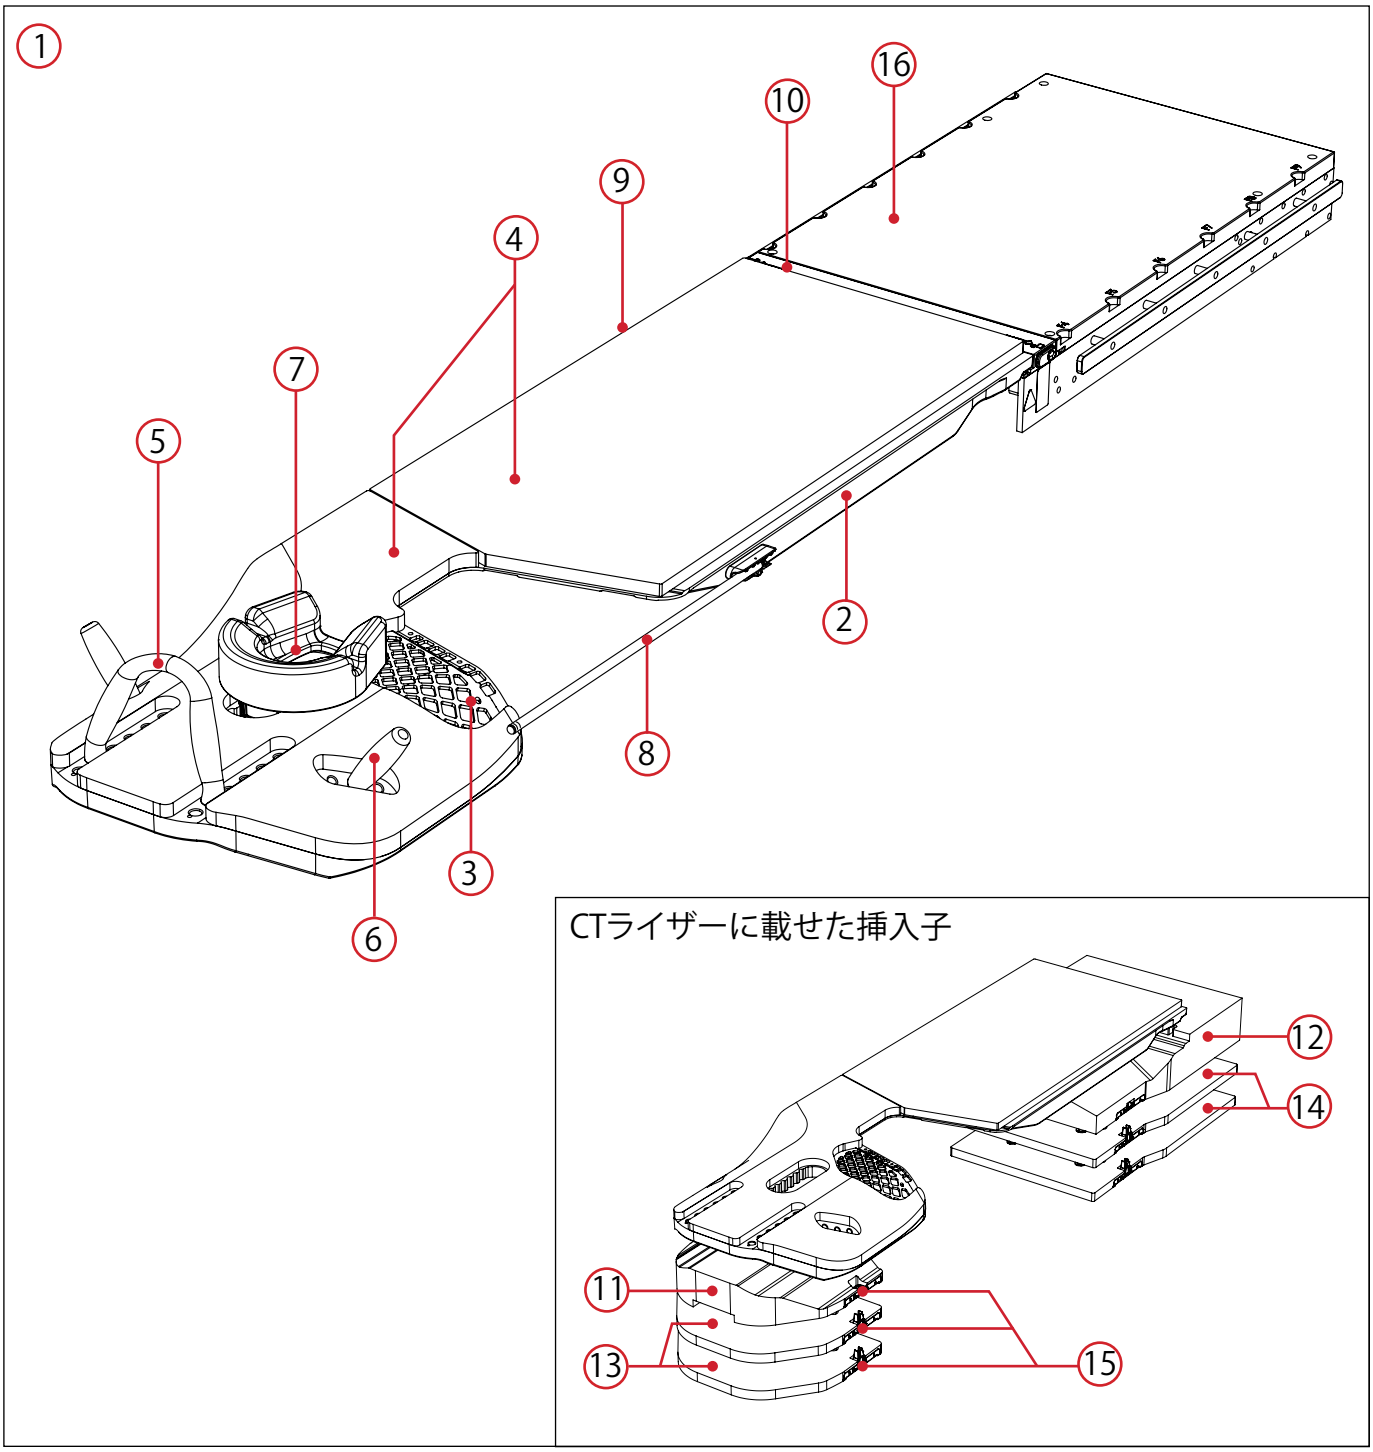

各部の機能

KVUE™ ACCESS 360™ G2 構成部品

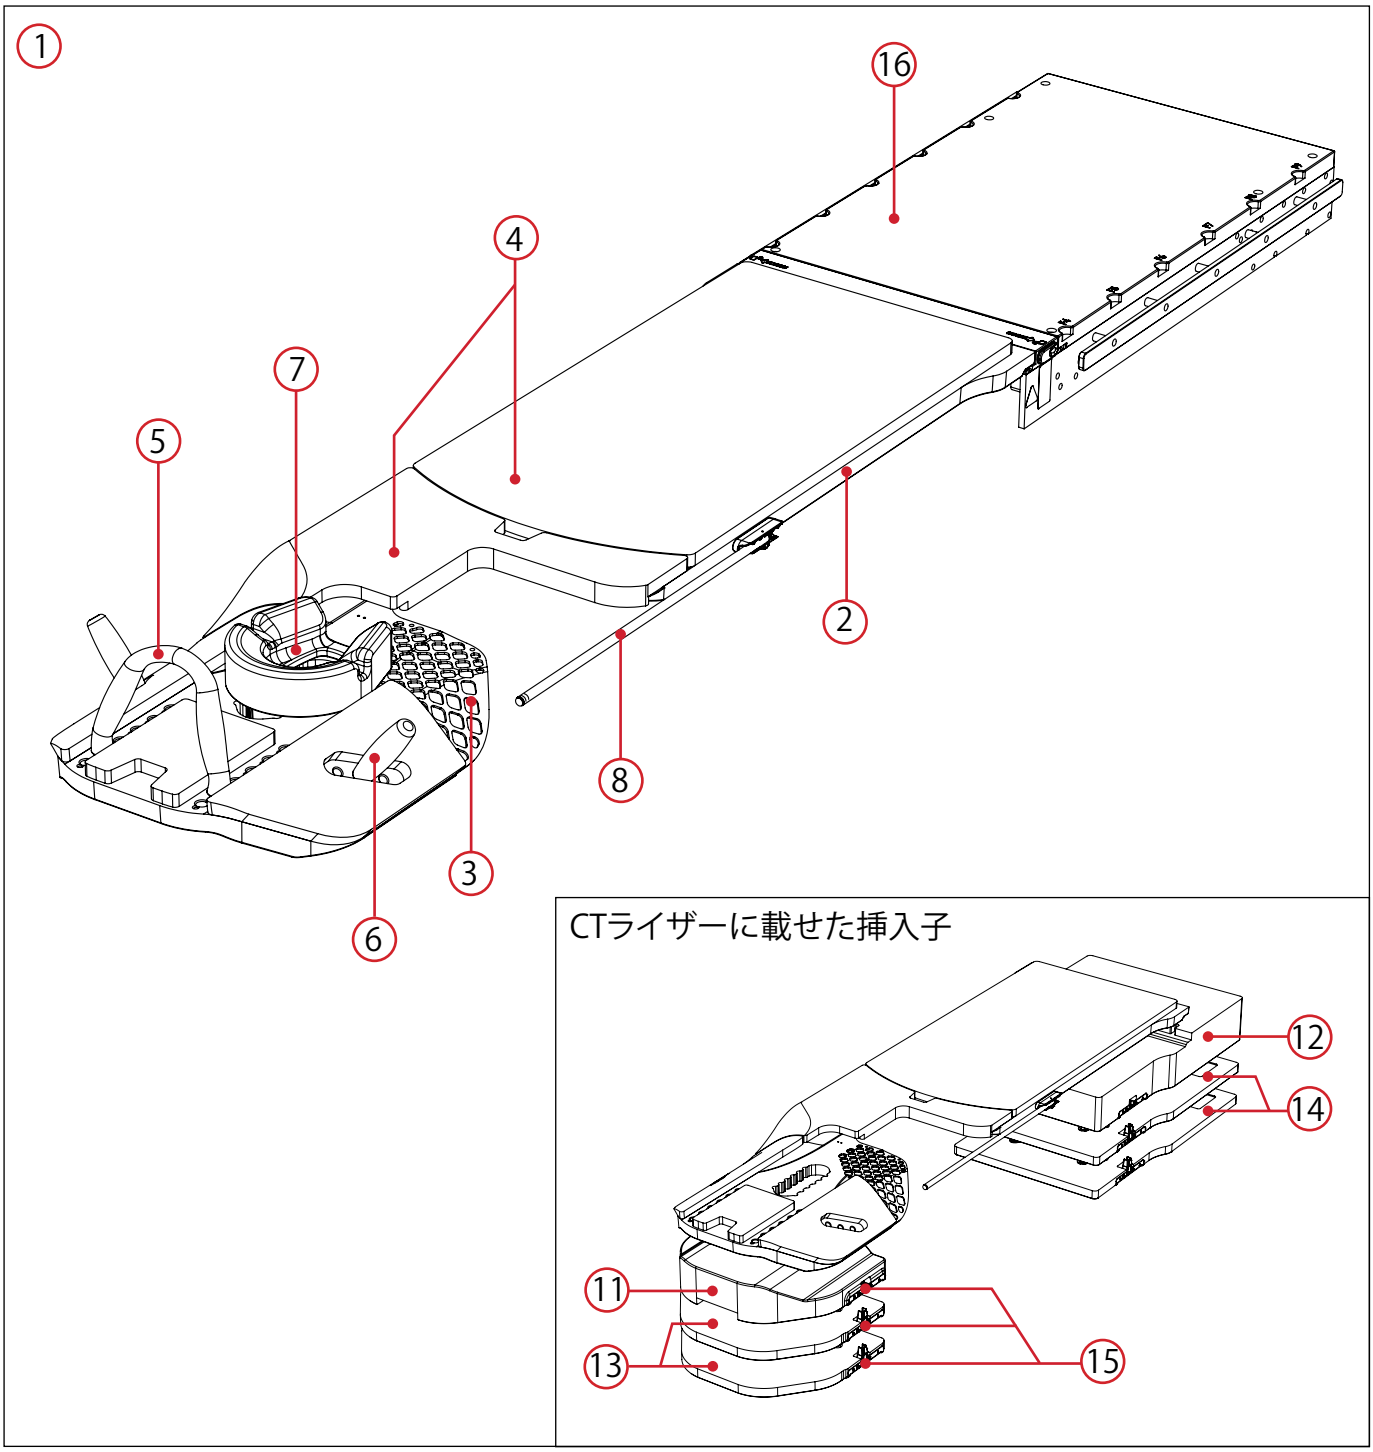

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

各部の機能

構成部品

1. KVUE™ ACCESS 360™ そして KVUE™ ACCESS 360™ G2 腹臥位用乳房カウチトップ挿入子システム

Access 360™ そして kVue Access 360™ G2 は、乳房および鎖骨領域の放射線治療を腹臥位で受ける患者の位置決めとセットアップの補助に使用します。

2. KVUE™ ACCESS 360™ そして KVUE™ ACCESS 360™ G2腹臥位用乳房カウチトップ挿入子

kVueシステムを使うと、右および左のAccess 360™ & Access 360 G2だけでなく、他のkVueカウチトップ挿入子の間でもすばやく容易に交換できます。挿入子には、鎖骨領域の治療を可能にするグリッドが含まれています。

3. 鎖骨上部グリッド

鎖骨上部グリッドは低減衰で、鎖骨領域の治療を可能にします。

4. クッション

クッションは患者の快適性を高めるためのものですが、取り外して真空クッションを使用することもできます。クッションにも患者の位置決め用グラフィックが付いています。

5. デュアルハンドグリップ

デュアルハンドグリップは、他のデバイスに使用されている標準的なポストと異なり、患者の手首への負担を減らすように人間工学的に設計されています。

6. ハンドグリップポスト

ハンドグリップポストは、動きの範囲が限られている患者が使用できます。

7. ヘッドレスト

このシステムには、腹臥位用ヘッドレストと成形ヘッドレストが装備されています。セットアップの指定により、どちらを使用することもできます。患者の身長に合わせて、複数の位置で挿入子に合わせることができます。

8. 同側目盛り

同側目盛りは、上位方向に回転して固定し、セットアップに使用します。治療および保管する時は下位方向に回転して元に戻します。目盛りは、位置合わせの補助に使用することができます。精度は±1 mmです。

9. 対側目盛り

Access 360: 対側目盛りは挿入子の対側にあり、位置合わせの補助に使用できます。目盛りの精度は±1 mmです。（Access 360用のみ）

Access 360 G2: Access 360 G2：反対側には、他の同側スケールを使用できます。Access 360 G2：

10. 下位目盛り

下位目盛りは挿入子の膝マークの下にあり、位置合わせの補助に使用できます。目盛りの精度は ±1 mmです。（Access 360用のみ）

各部の機能

構成部品

11. 上位CTライザー

上位CTライザーは、位置決めバーを使用してCTオーバーレイに合わせます。シミュレーション中に挿入子の上位の端を13 cm持ち上げ、下位CTライザーと一緒に使用します。

12. 下位CTライザー

下位CTライザーは、位置決めバーを使用してCTオーバーレイに合わせます。シミュレーション中に挿入子の下位の端を13 cm持ち上げ、上位CTライザーと一緒に使用します。

13. 上位CTライザーシム

CTライザーシムは、位置決めバーに合わせて上位CTライザーを2.5 cm単位で持ち上げます。このシムは、別の上位CTライザーシムや上位CTライザーにはめ込むことができます。

14. 下位CTライザーシム

CTライザーシムは、位置決めバーに合わせて下位CTライザーを2.5 cm単位で持ち上げます。このシムは、別の下位CTライザーシムにはめ込むことができ、また下位CTライザーにネジで固定することができます。

15. インデックスプレート

CTライザーには、インデックスプレートが付いています。インデックスプレートは、位置決めバーを使用してCTライザーをカウチトップに配置します。CTライザーに付いているインデックスプレートは、高さ調整用のCTシムのインデックスプレートにはまります。

16. kVue™カウチトップ

kVueカウチトップは、原機器のカウチベースを除く、完全な患者支持システムです。本製品は、ベースフレーム（支持ビームを含む）、インターフェースプレート（必要な場合）、そして該当するkVueカウチトップ挿入子から構成されています（より詳細な説明については、kVue製品の取付けおよびユーザーマニュアルを参照してください）。

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

操作方法

セットアップ

位置決めバー

位置決めバーには、ほとんどの標準的な位置決め用付属品に合う位置決めピンが2つ付いています。装着するには、位置決めバーのどちらか一端を、該当するVarian Exact® 互換性の指標ノッチに差込み、所定の位置にパチンとはめ込みます。取り外したり、位置を直すには、位置決めバーのいずれかの端を引き上げます。

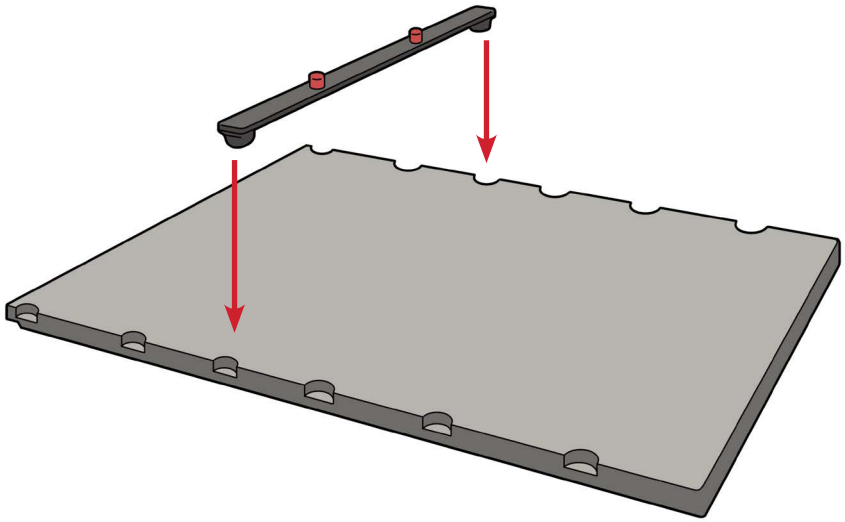

操作方法

! 注記 !デバイスは長いため、取付けと取外しは2人で行うことが奨励されます。

オーバーレイへのCTライザーとCTシムの取付け

1. 2本の位置決めバーを1260 mm（通常はインデックスノッチ9個分）の間隔を開けて取り付け、所定の位置にパチンと固定します（図1と2）。

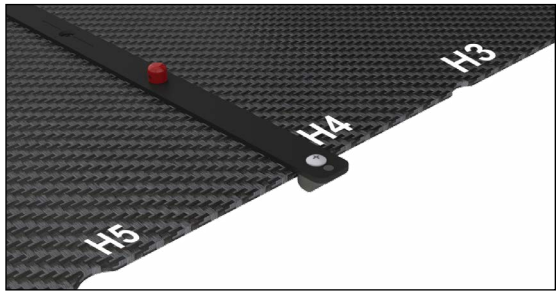

図 1

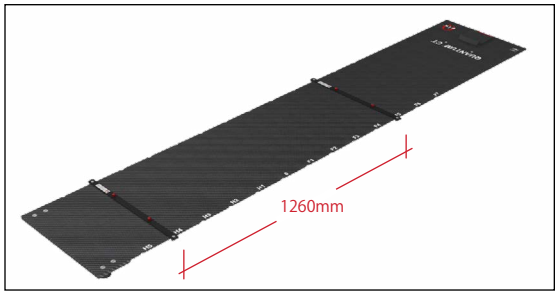

図 2

2. CTライザーとCTシムをご希望のセットアップに応じて、位置決めバーに載せます（図3と4）。下位と上位のCTライザーA、B、C、またはDの同じ位置を使用して、CTライザーとCTシムを位置合わせしてください（図5、6、7）。シムは2.5 cmごとに高さが高くなるよう重ねることができます。

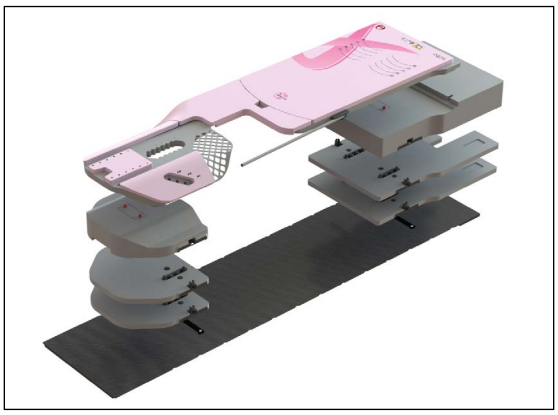
図 3

または

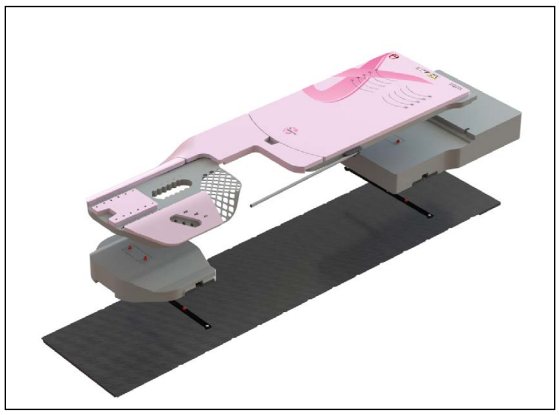
図 4

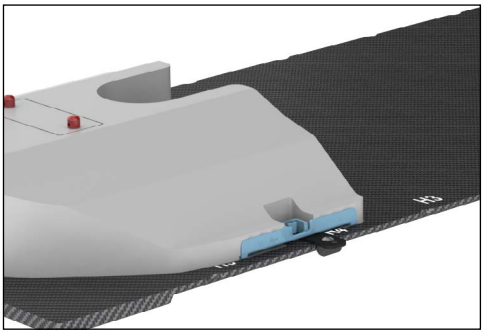
図 5

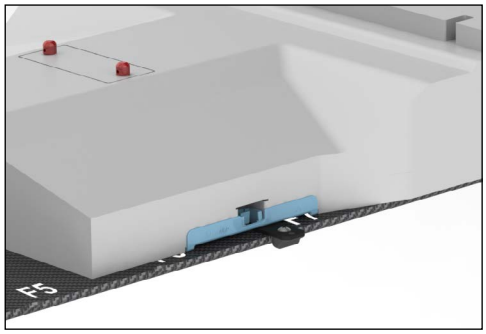

図 6

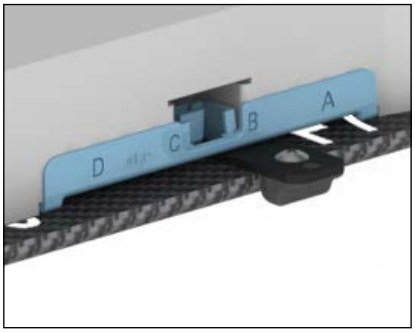

図 7

操作方法

3. デバイスの高さを低くする、またはCTライザーとCTシムを取り外すには、Access 360またはAccess 360 G2を取り外します。インデックスプレートの各側のリリースボタンを押します。ボタンを押しながら、CTライザーまたはCTシムをその下のCTシムから引っ張り、取り外します（図8）。

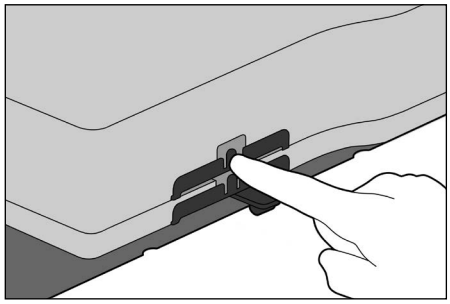

図 8

操作方法

取付け

! 注記 ! デバイスは長いため、取付けと取外しは2人で行うことが推奨されます。

カウチトップ挿入子の取付け

1. kVueカウチトップ挿入子を支持ビーム上部に置き、2つの連結ピンをOneTouch Latchラッチの受入れ孔に一致させます。
2. kVueカウチトップの頭側末端から、カウチトップ挿入子を直接受け入れ孔にスライドさせます。カウチトップ挿入子が所定の位置でロックされると、クリック音が聞こえます。正しく取り付けると、緑色のボタンの表面のみが見えるようになります。

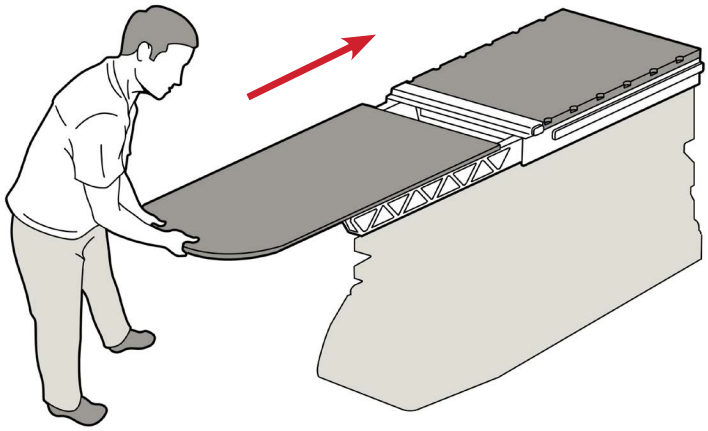

カウチトップ挿入子の取外し

! カウチトップ挿入子の端を決して持ち上げないでください ! この装置は非常に頑丈にできていますが、連結ピンが曲がったり折れたりしてカウチトップが使用できなくなることがあります。

1. レバーを反時計回りに回します。
2. カウチトップ挿入子が離れるまで、レバーを引張ります。これは片手で行なうことができます。
3. カウチトップ挿入子をカウチトップからスライドさせて引き抜きます。

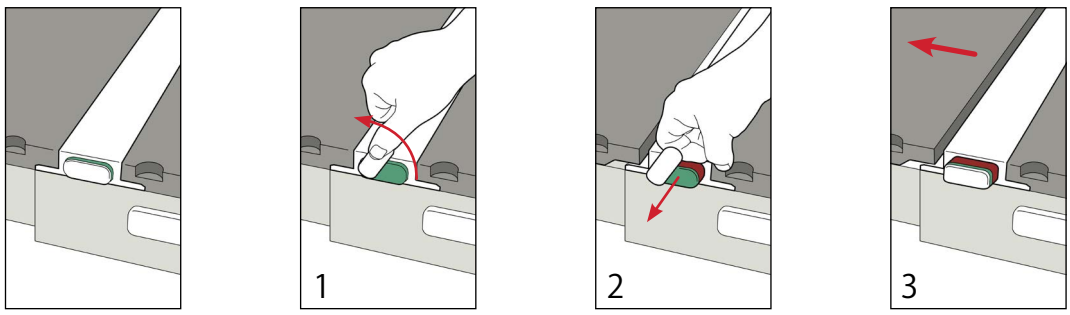

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

操作方法

セットアップ

ヘッドレスト

1. 患者に使用する腹臥位用ヘッドレストまたは成形ヘッドレストを選びます。（下図には腹臥位用ヘッドレストを示します）
2. プラスチック製の位置合わせ部を、デバイスの上位の端にある適切なスロットに (A, B, C, D, E, F) 挿入します (図9と10）。
3. ヘッドレストを取外すまたは位置を直すには、ヘッドレストを挿入子から上の方に引っ張ります。

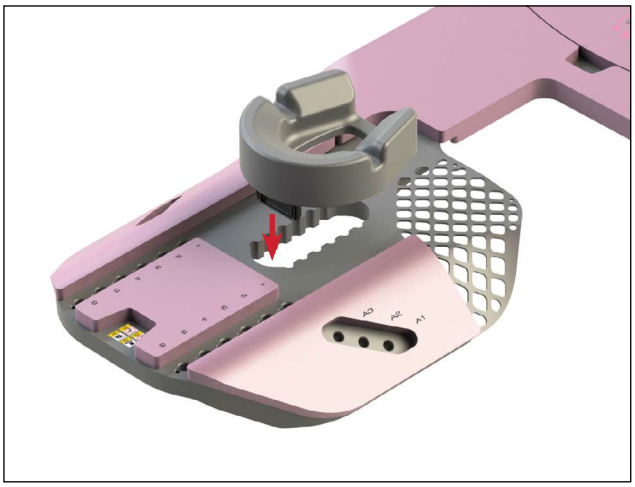

図 9

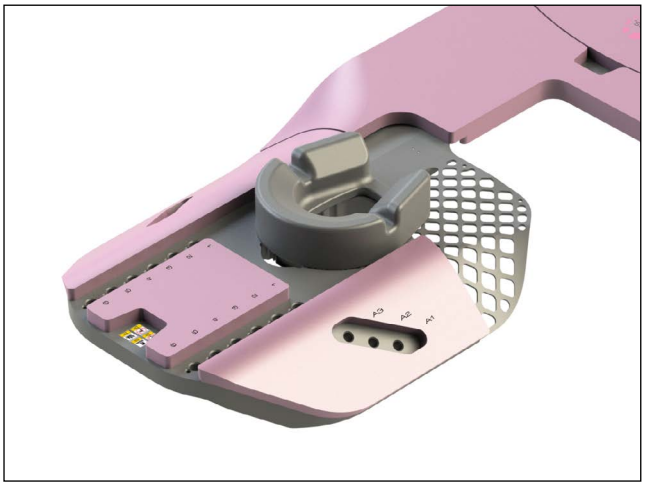

図 10

操作方法

セットアップ

デュアルハンドグリップ

! 警告 ! デュアルハンドグリップとハンドグリップポストは、患者の体重を支えるようには設計されていません。

- **患者を配置するためにデュアルハンドグリップやハンドグリップポストを使用しないでください。**
- **デバイスの乗り降りにデュアルハンドグリップやハンドグリップポストを使用しないでください。**

1. デュアルハンドグリップを、挿入子の上位の端にある対応する孔(1 2 3 4 5 6) に挿入します。
2. 孔にパチンとはまるまで、デュアルハンドグリップを下に押し込みます(図11と12) 。

! 注記 ! デュアルハンドグリップは、以下の図のようにアーチが患者の方に傾くよう取付けます(図10) 。

3. デュアルハンドグリップを取外す、または位置を直すには、孔から外れるまで、上の方に引っ張ります (図11と13) 。

! 注記 ! デュアルハンドグリップを取外す時は、挿入子が持ち上がらないように挿入子の上部を押さえて圧力をかけます。メカニズムは頑丈に作られていますが、連結ピンが曲がったり折れたりしてカウチトップが不安定になることがあります。

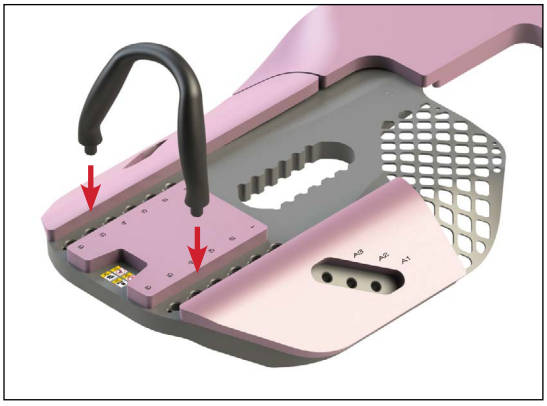

図 11

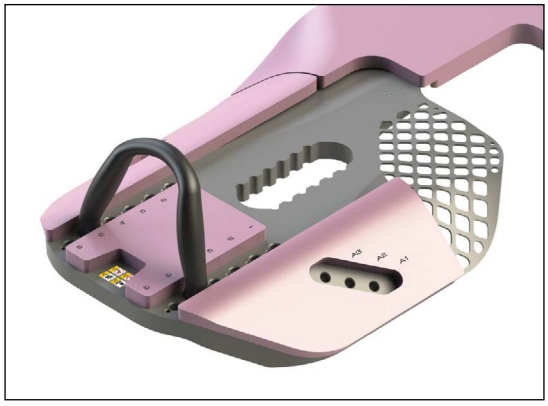

図 12

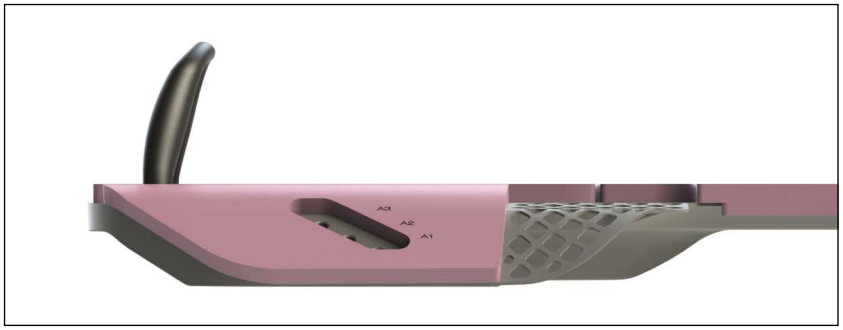

図 13

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

操作方法

セットアップ

ハンドグリップポスト

1. ハンドグリップポストを、挿入子の上位の端にある適切な孔(A1 A2 A3)に挿入します (図14) 。
2. ハンドグリップポストが孔にしっかりと締まり、所定位置に固定されるまで、ハンドグリップポストを左右どちらかの方向に回転させます (図15) 。
3. ハンドグリップポストを取外すには、ハンドグリップポストが緩むまで取付けた方向と反対に回転させてから、まっすぐ引き出します (図14と15) 。

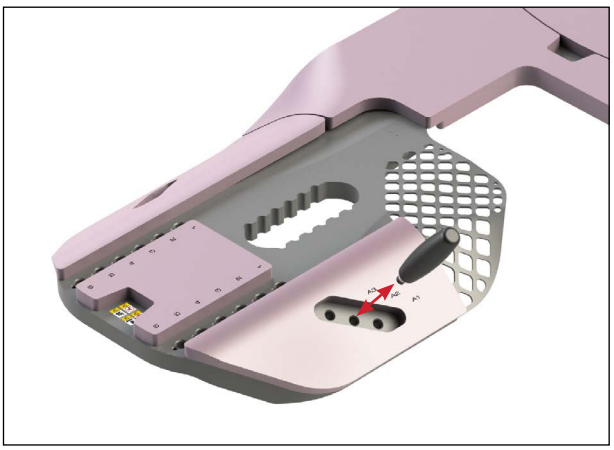

図 14

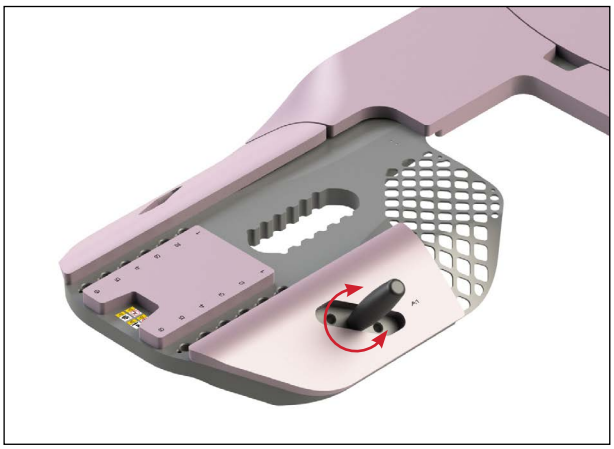

図 15

操作方法

患者のポジショニング

! 注記 ! 患者がデバイスに乗り降りする時に、患者を手助けする必要がある場合があります。以下の説明は当社が勧める方法ですが、各医療機関で調整することができます。

ACCESS 360™ そして ACCESS 360™ G2 の取付けおよび取外し方法

1. カウチを下げるか、踏み台を使って患者が挿入子に乗る手助けをします。
2. 患者が挿入子に乗ったら、患者の膝をフォーム上の適切な印に合わせます。
3. 患者に両手または両肘をついて上半身を所定位置に移動させます。
4. 患者にゆっくりと身体を所定位置に横たえさせます。
5. 所定位置になったら、患者の頭部をヘッドレスト内に載せ、適切な ハンドグリップポストを握らせます。
6. 挿入子から降りるには、上記の手順を逆に行います。

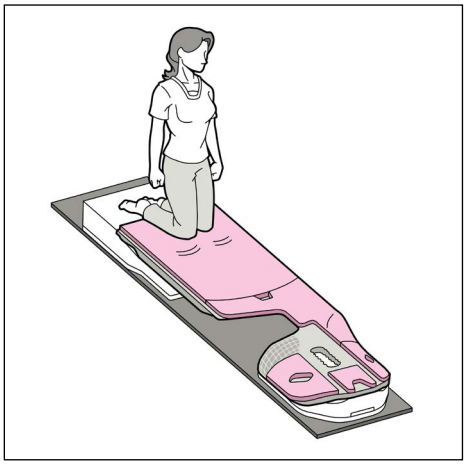

図 16

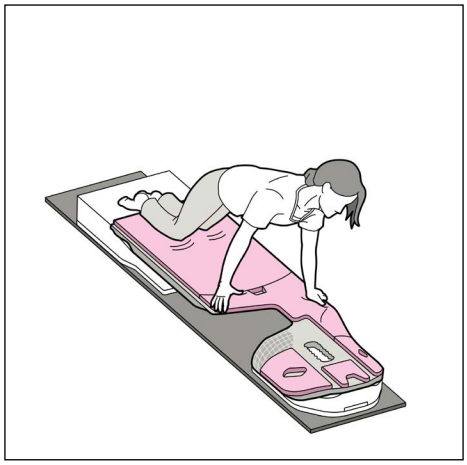

図 17

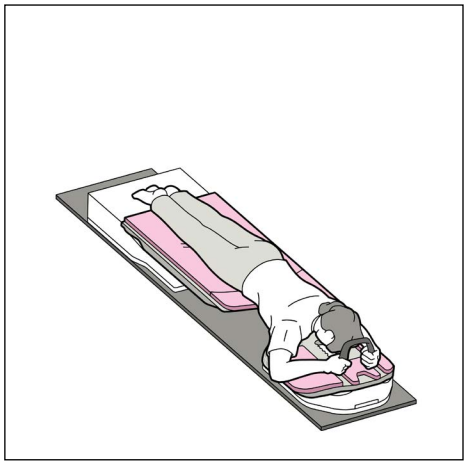

図 18

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

操作方法

セットアップ

同側目盛り

! 警告 ! 同側目盛りは、患者の体重を支えるようには設計されていません。

1. 患者が所定位置についたら、同側目盛りを、所定位置に固定されるまで上位方向に回転させてます (図20) 。
2. 患者の位置を合わせます。

! 注記 ! 目盛りは、位置合わせに役立てるために装備されています。患者の位置決めを確認することは使用者の責任です。

! 注記 ! 目盛りの精度は± 1 mmまで試験されています。

3. 治療および/または保管前に、同側目盛りを保管位置まで下位方向に回転させます(図19と20) 。

図 19: 保管位置

図 20

メンテナンス

システムのクリーニング

本デバイスは、刺激が少なく、研磨剤の入っていない洗浄液や消毒液で清拭してください。クリーニングする際は、溶液を浸した清潔な布で表面を拭きます。デバイスを目視点検し、汚れている場合は、きれいになるまで上記のクリーニング手順を繰り返します。水で湿らせた清潔な布でデバイスを拭き、残った洗浄剤を取り除きます。乾かすには、デバイスを清潔で乾いた布で拭きます。本デバイスのクリーニングには、以下の洗浄剤がテストの結果適切とされています。

- 水
- 石鹸および水

システムの消毒

デバイス表面を消毒する際は、洗浄剤メーカーからの具体的な指示に従ってしてください。

- 10% Clorox®ブリーチ液
- イソプロピルアルコール
- Cidex® 2.4%活性化ジアルデヒド液

絶対に、カウチトップやカウチトップ挿入子に直接スプレーしたり、ベースフレームに液体が流れることがないようにしてください。

カウチトップやカウチトップ挿入子上には鋭利な物を置かないでください。

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

仕様

ACCESS 360™

重量制限：等分布加重（デバイス全体に均一にかかる荷重）200 kg

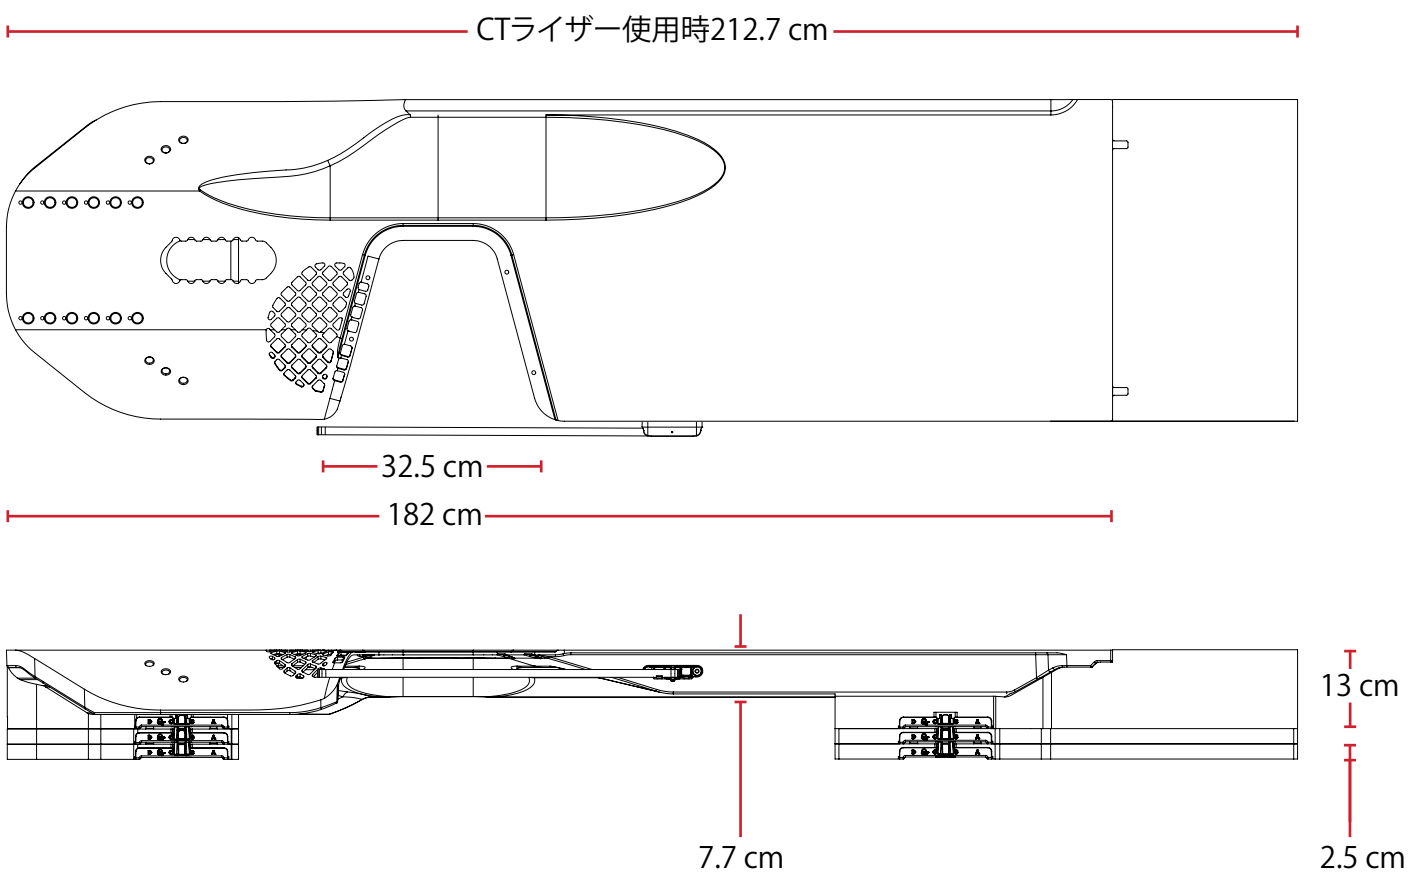

仕様

ACCESS 360™ G2

重量制限：等分布加重（デバイス全体に均一にかかる荷重）200 kg

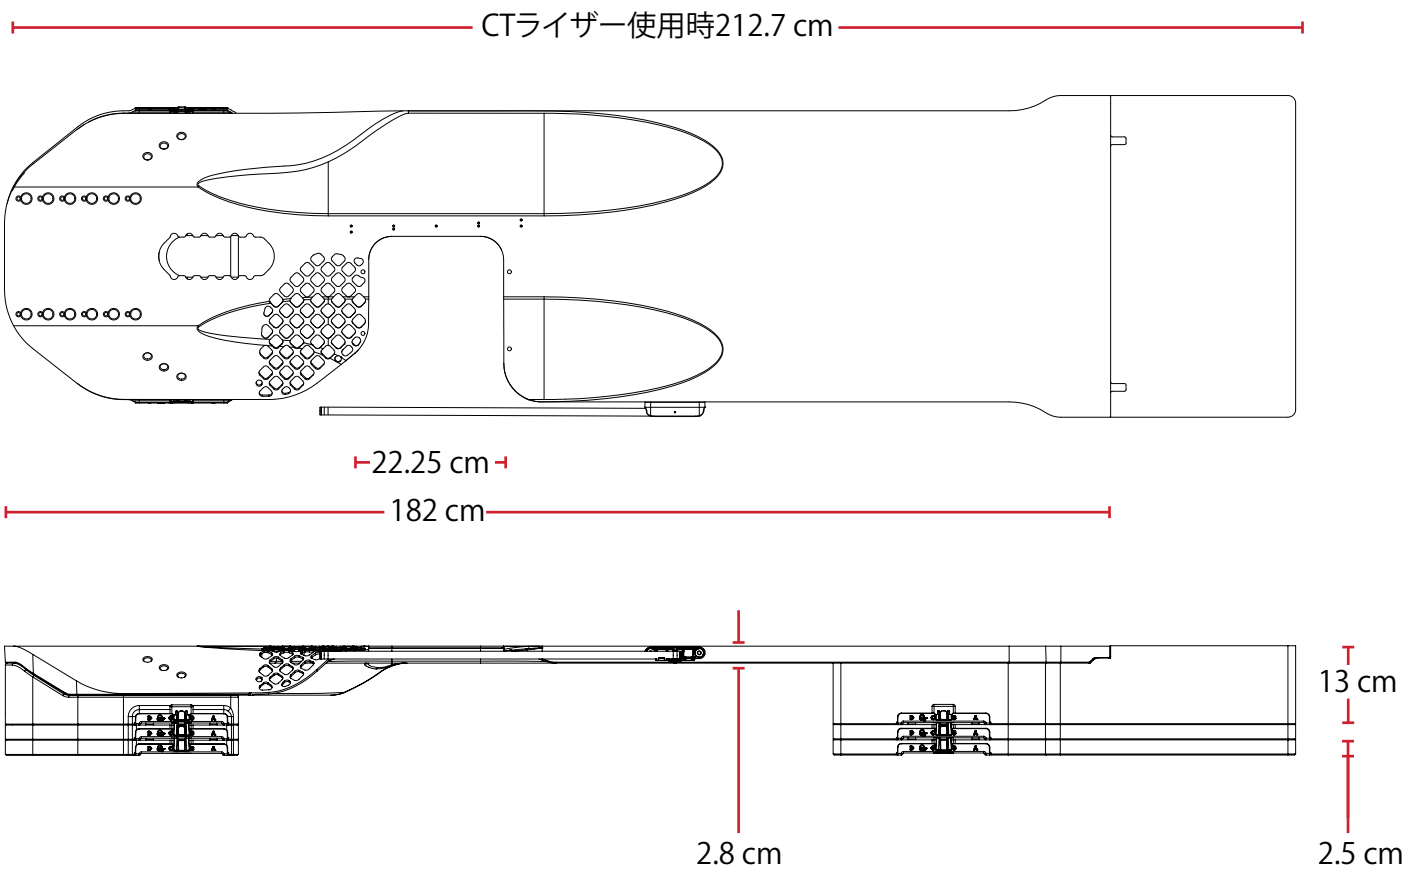

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

患者のセットアップ

KVUE™ ACCESS 360™カウチトップ挿入子

患者名：

患者ID番号：　　セットアップ担当者：

医師：　　日付：

コメント：

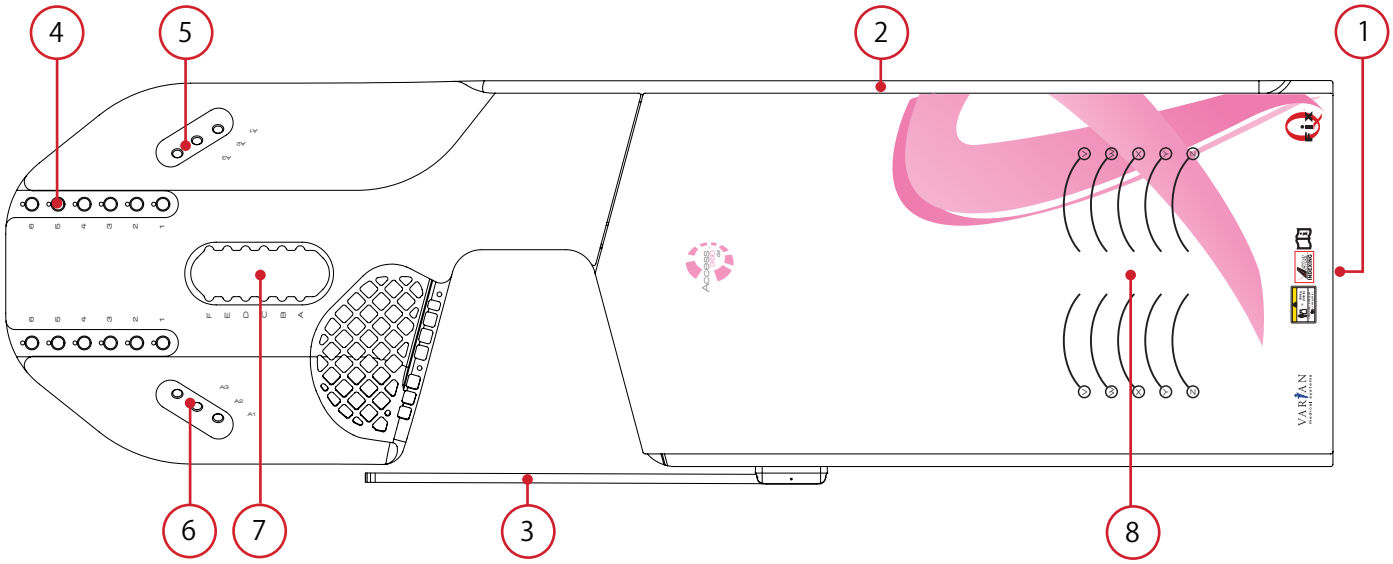

☐ 左側挿入子　　☐ 右側挿入子

！注記！上図には左側挿入子を示します。

1. ⑦位の位置合わせ：
2. 対側目盛り：
3. 同側目盛り：
4. デュアルハンドグリップの位置（いずれかを選択）：**1** ☐ **2** ☐ **3** ☐ **4** ☐ **5** ☐ **6** ☐ **該当しない** ☐
5. ハンドグリップポスト、患者右側（いずれかを選択）：**A1** ☐ **A2** ☐ **A3** ☐ **該当しない** ☐
6. ハンドグリップポスト、患者右側（いずれかを選択）：**A1** ☐ **A2** ☐ **A3** ☐ **該当しない** ☐
7. 使用するヘッドレスト：**なし** ☐ **腹臥位用** ☐ **成形** ☐ 位置（いずれかを選択）：**A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐ **F** ☐
8. 膝の位置（いずれかを選択）：**V** ☐ **W** ☐ **X** ☐ **Y** ☐ **Z** ☐
9. 追加メモ：

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

患者のセットアップ

KVUE™ ACCESS 360™カウチトップ挿入子 (続き)

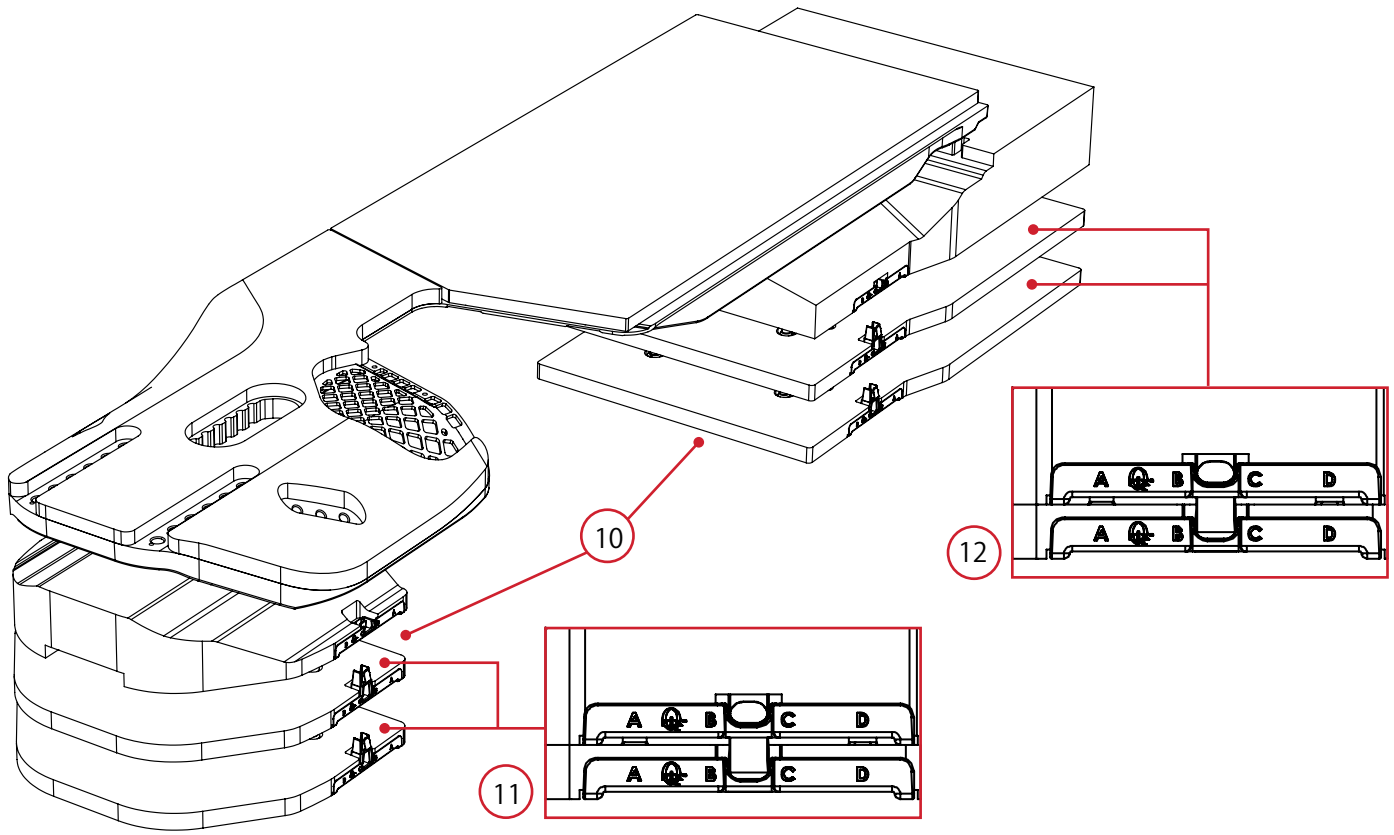

！注記！上図には左側挿入子を示します。

CTライザーとシム

10. 使用するCTライザーシムの個数（いずれかを選択）： **0** ☐ **1** ☐ **2** ☐ **3** ☐

11. 位CTライザー - 位置決めバーの位置（いずれかを選択）： **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐
    11a) カウチトップ上の位置決めバーの位置：

12. 下位CTライザー - 位置決めバーの位置（いずれかを選択）： **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐
    12a) カウチトップ上の位置決めバーの位置：

13. 追加メモ：

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

患者のセットアップ

KVUE™ ACCESS 360™ G2カウチトップ挿入子

患者名：

患者ID番号：　　セットアップ担当者：

医師：　　日付：

コメント：

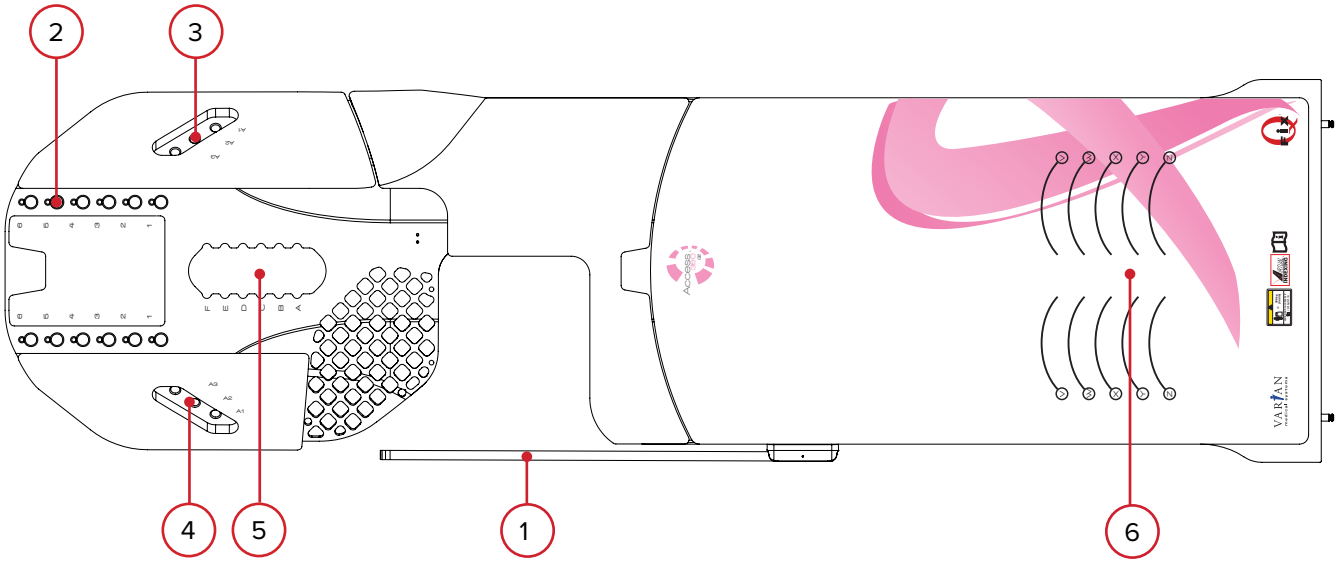

☐ 左側挿入子　　☐ 右側挿入子　　**！注記！上図には左側挿入子を示します。**

1. 同側目盛り：
2. デュアルハンドグリップの位置（いずれかを選択）：**1** ☐ **2** ☐ **3** ☐ **4** ☐ **5** ☐ **6** ☐ **該当しない** ☐
3. ハンドグリップポスト、患者右側（いずれかを選択）：**A1** ☐ **A2** ☐ **A3** ☐ **該当しない** ☐
4. ハンドグリップポスト、患者右側（いずれかを選択）：**A1** ☐ **A2** ☐ **A3** ☐ **該当しない** ☐
5. 使用するヘッドレスト：**なし** ☐ **腹臥位用** ☐ **成形** ☐ 位置（いずれかを選択）：**A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐ **F** ☐
6. 膝の位置（いずれかを選択）：**V** ☐ **W** ☐ **X** ☐ **Y** ☐ **Z** ☐
7. 追加メモ：

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

患者のセットアップ

KVUE™ ACCESS 360™ G2カウチトップ挿入子 (続き)

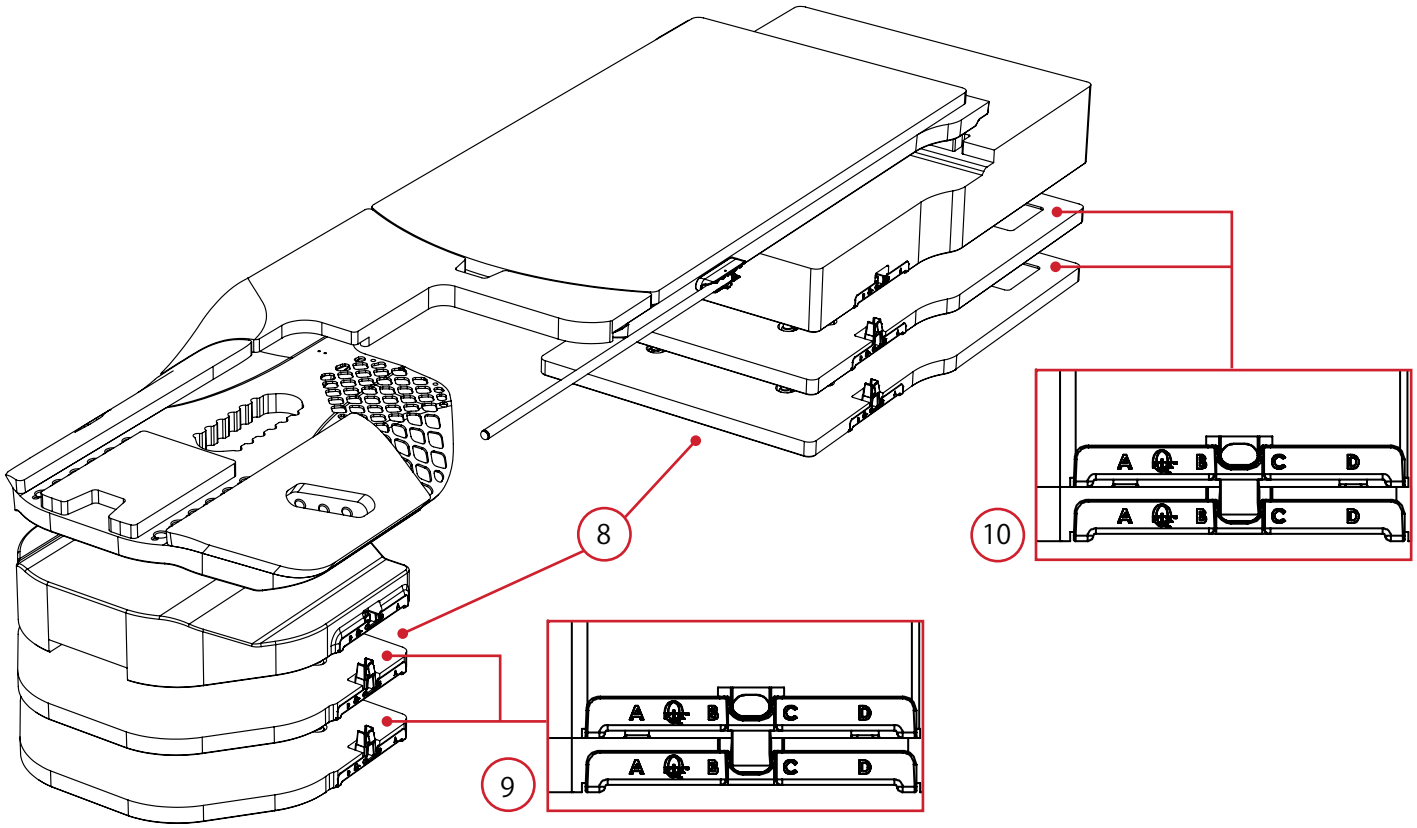

！注記！上図には左側挿入子を示します。

CTライザーとシム

8. 使用するCTライザーシムの個数（いずれかを選択）： **0** ☐ **1** ☐ **2** ☐ **3** ☐

9. 位CTライザー - 位置決めバーの位置（いずれかを選択）： **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐
   9a) カウチトップ上の位置決めバーの位置：

10. 下位CTライザー - 位置決めバーの位置（いずれかを選択）： **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐
    10a) カウチトップ上の位置決めバーの位置：

11. 追加メモ：

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

部品リスト

KVUE™ ACCESS 360™カウチトップ挿入子

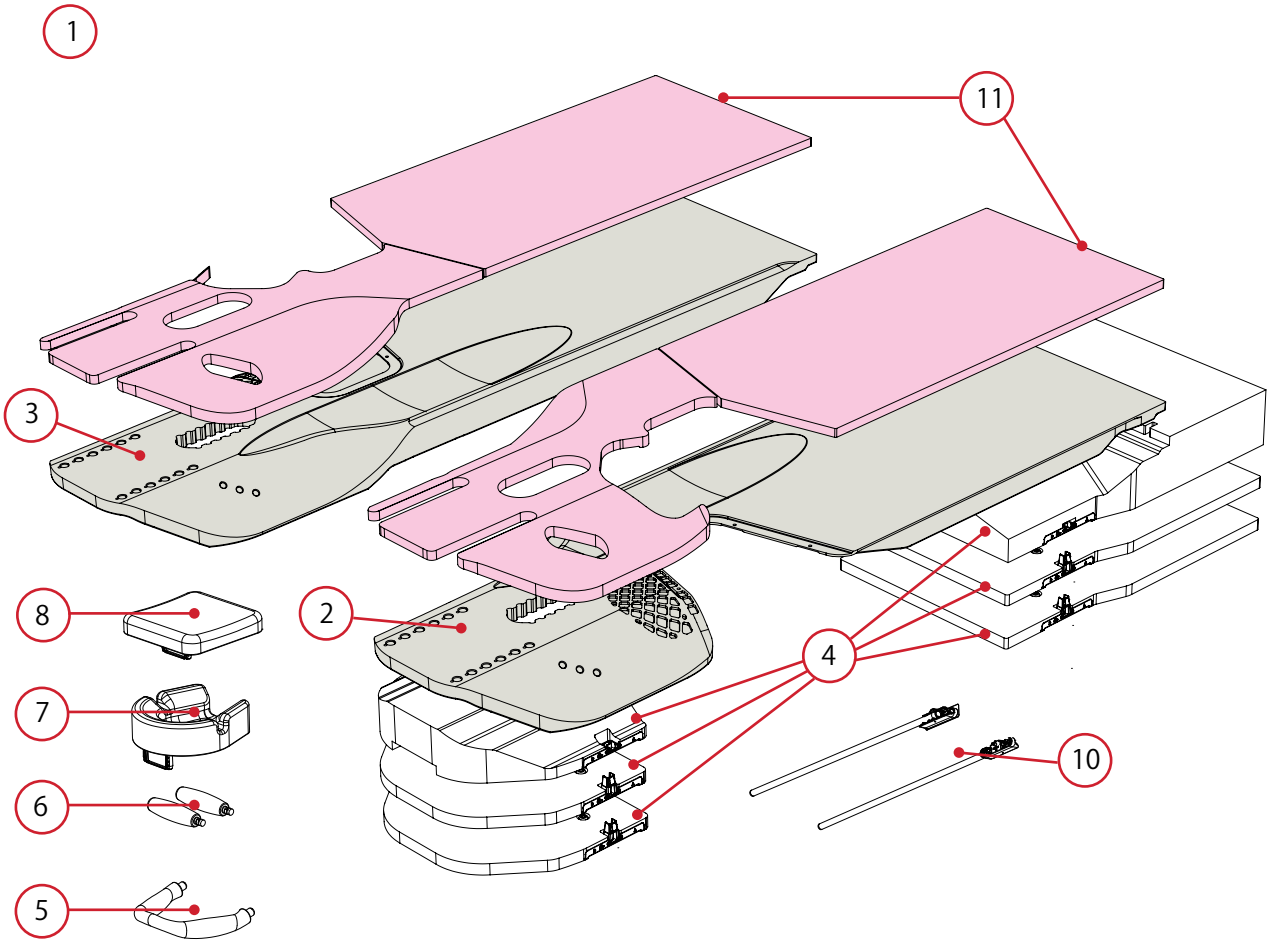

1. RT-4544KV – kVue Access 360 パッケージ
2. RT-4544KV-01 – kVue Access 360 Couch Top Insert カウチトップ挿入子 - 左乳房
3. RT-4544KV-02 – kVue Access 360 Couch Top Insert カウチトップ挿入子 - 右乳房
4. RT-4544KV-03 – kVue Access 360 CTライザーセット
5. RT-4544KV-04 – デュアルハンドグリップ
6. RT-4544KV-05 – ハンドグリップポスト
7. RT-4544KV-06 – 腹臥位用ヘッドレスト
8. RT-4544KV-07 – 成形ヘッドレスト
9. RT-4551CART – 保管カート（表示なし）
10. 8001846 – 同側目盛り
11. 8001946 – Access 360パッドセット

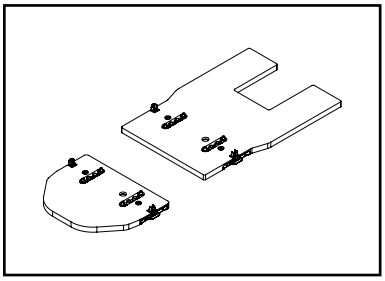

RT-4544KV-03A

kVue™ Access 360™シムセット（別売り

部品リスト

KVUE™ ACCESS 360™ G2カウチトップ挿入子

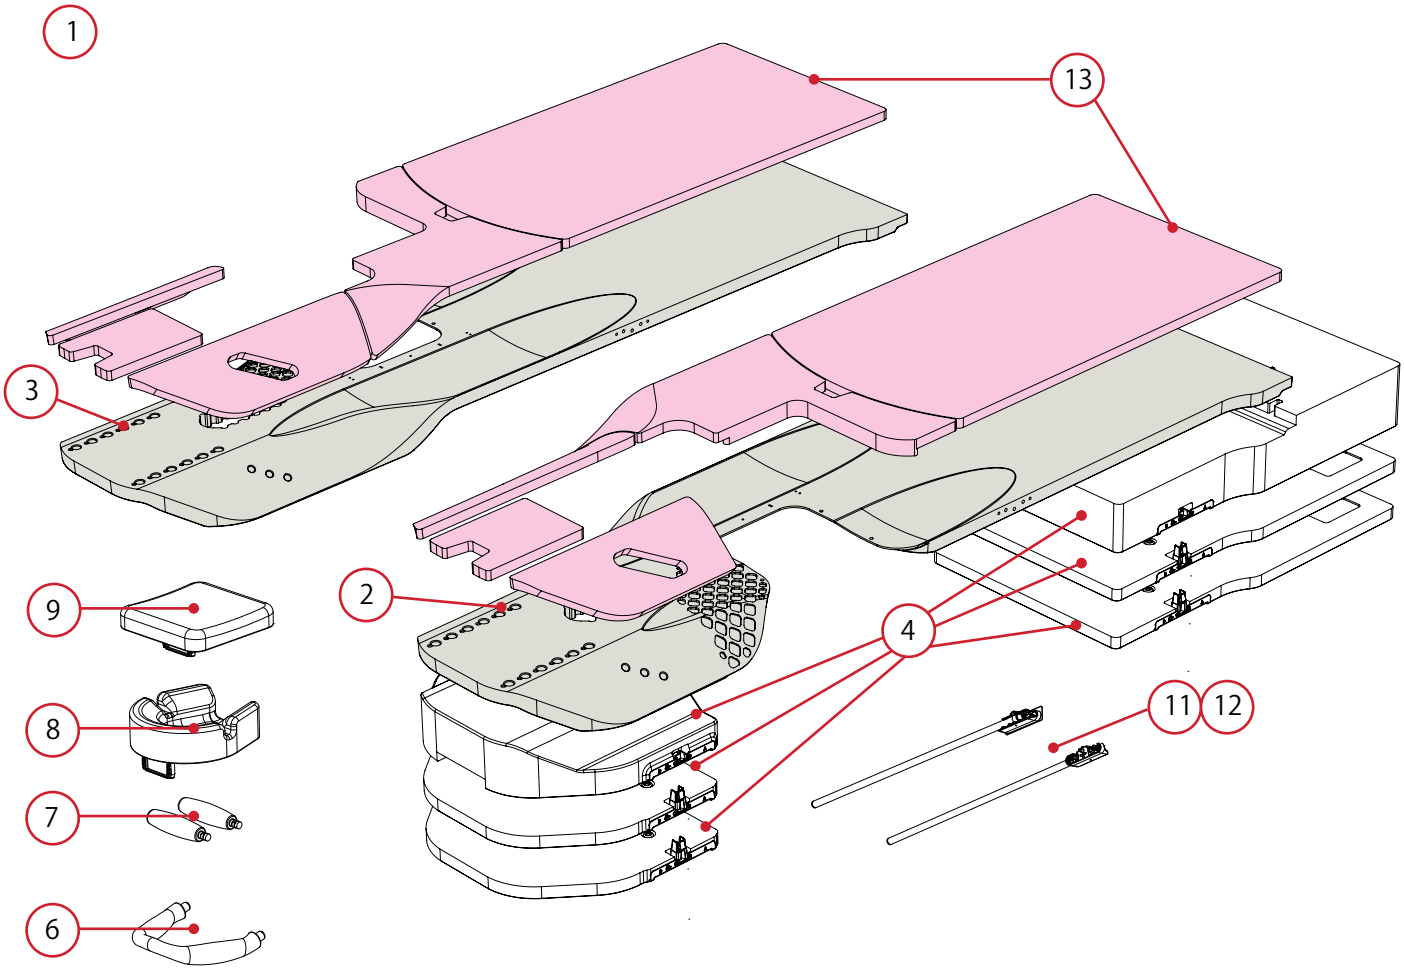

1. RT-4544KV-10 – kVue Access 360 G2 パッケージ
2. RT-4544KV-11 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert カウチトップ挿入子 - 左乳房
3. RT-4544KV-12 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert カウチトップ挿入子 - 右乳房
4. 8002581 – kVue Access 360 G2 CTライザーセット
5. 8002579 – kVue Access 360 G2シムセット
6. RT-4544KV-04 – デュアルハンドグリップ
7. RT-4544KV-05 – ハンドグリップポスト
8. RT-4544KV-06 – 腹臥位用ヘッドレスト
9. RT-4544KV-07 – 成形ヘッドレスト
10. RT-4551CART – 保管カート（表示なし）
11. 8002601 – 40 cm 同側目盛り（交換用）
12. 8002602 – 48 cm 同側目盛り（付属品）
13. 2007045 – Access 360 G2パッドセット

5

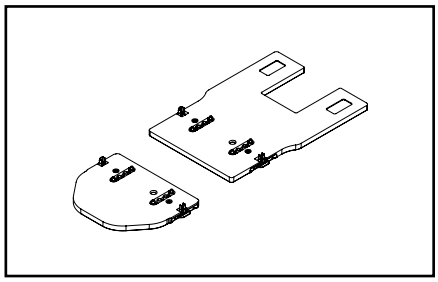

8002579

kVue™ Access 360™ G2シムセット（別売り）

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | +1 610-268-0585 | +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247
+1 610.268.0588 / 800.831.8174
sales@Qfix.com

2002686_JA_E
2021-07